

Female Shifting Pyramid Adapter

Instructions for Use

189128

EN	Instructions for Use	2
FR	Instructions d'utilisation	12
DE	Gebrauchsanweisung	22
IT	Istruzioni per l'uso	32
ES	Instrucciones de uso	42
NL	Gebruiksaanwijzing	52
PL	Instrukcje użytkowania	62
PT	Instruções de utilização	72
CS	Návod k použití	82

Contents

EN

Contents	2
1 Description and Intended Purpose	3
2 Safety Information	4
3 Construction	5
4 Function.....	6
5 Maintenance	6
6 Limitations on Use	7
7 Assembly and Alignment	7
8 Technical Data	10
9 Ordering Information	10

1 Description and Intended Purpose

These Instructions for Use are intended for the practitioner and user unless otherwise stated.

The term *device* is used throughout to refer to the Female Shifting Pyramid Adapter.

Please read and ensure you understand these instructions, in particular all safety information and maintenance instructions.

Application

This device is to be used exclusively for modular lower limb prostheses, intended for a single user.

The device is designed to connect an open ended Blatchford slotted chassis or top housing to a male pyramid receiver. This allows for shifting, angular and rotational adjustment between the two limb parts.

Features

- Lightweight, strong, titanium and aluminum construction

Activity Level

This device is suitable for Activity Levels 1-4 (weight limits apply, see *Technical Data*). Of course there are exceptions and in our recommendation we want to allow for unique, individual circumstances and any such decision should be made with sound and thorough justification.

Activity Level 1

Has the ability or potential to use a prosthesis for transfers or ambulation on level surfaces at fixed cadence. Typical of the limited and unlimited household ambulator.

Activity Level 2

Has the ability or potential for ambulation with the ability to traverse low-level environmental barriers such as curbs, stairs, or uneven surfaces. Typical of the limited community ambulator.

Activity Level 3

Has the ability or potential for ambulation with variable cadence. Typical of the community ambulator who has the ability to traverse most environmental barriers and may have vocational, therapeutic, or exercise activity that demands prosthetic utilization beyond simple locomotion.

Activity Level 4

Has the ability or potential for prosthetic ambulation that exceeds basic ambulation skills, exhibiting high impact, stress, or energy levels. Typical of the prosthetic demands of the child, active adult, or athlete.

Contraindications

There are no known contraindications if used in accordance with these instructions.

Clinical Benefit

Provides a connection between prosthetic componentry that allows some adjustment in alignment.

2 Safety Information



This warning symbol highlights important safety information which must be followed carefully.

! Any changes in the performance or function of the limb, e.g. excessive play or unusual noises, should be immediately reported to your service provider.

! Always use a hand rail when descending stairs and at any other time if available.

! The device can be used as shower prosthesis but is not designed for prolonged submersion in water. After contact with water wipe dry immediately. If this device comes into contact with salt or chlorinated water, it should be rinsed with fresh water and dried. Ensure any use of the device in water complies with the conditions given in *Limitations on Use*.

! Assembly, maintenance and repair of the device must only be carried out by a suitably qualified practitioner.

! The user must not adjust or tamper with the setup of the device.

! The user is advised to contact their practitioner if their condition changes.

! To reduce the risk of injury due to failure or loosening of the bolt connections, ensure the bolt threads are cleaned thoroughly before each installation.


! Always apply the specified torque value to the screws.

3 Construction

Principal Parts

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| • Female Pyramid | Titanium |
| • Collar/Clamp Ring | Aluminum alloy |
| • Pyramid Set Screws | Plated steel (x4) |
| • Clamp Screw and Inserts | Plated steel |

Component Identification

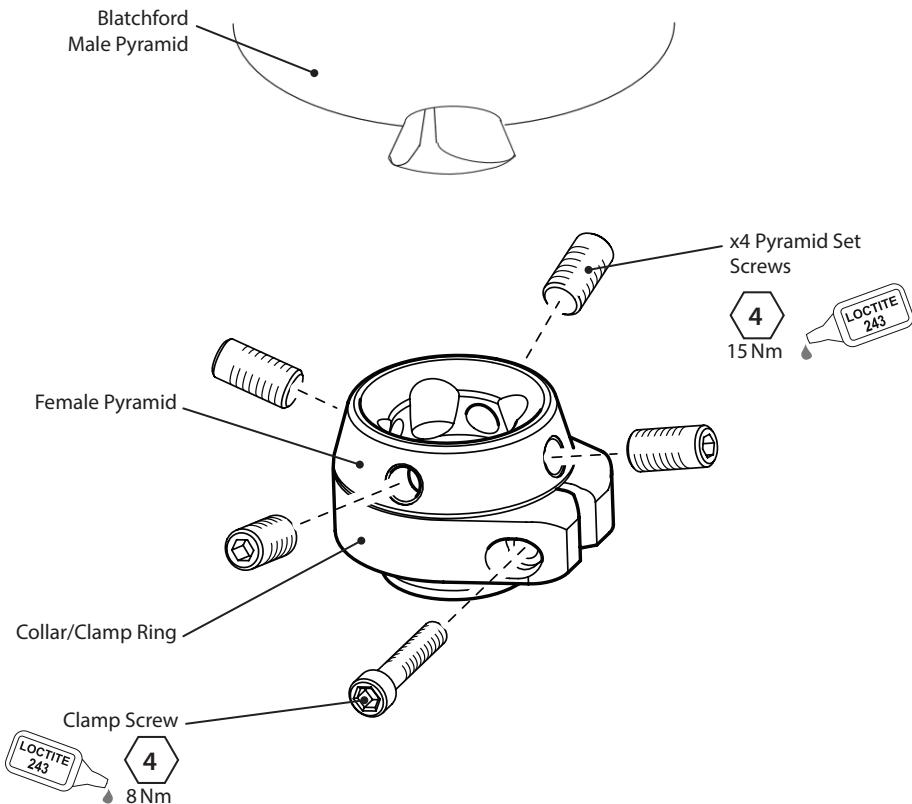

4 Function

This device comprises two main components. The movement between these two components prior to tightening the pyramid screws and clamp screw allows for alignment of the limb to suit the individual user. When tightened securely using Loctite 243 and torque settings shown, the device offers a secure way to connect the two parts of the limb.

5 Maintenance

Visually check the device regularly.

Report any changes in performance of this device to the practitioner/service provider e.g. unusual noises, movement or significant wear.

Inform the practitioner/service provider of any changes in body weight and/or activity level.

Cleaning

Use a damp cloth and mild soap to clean outside surfaces. DO NOT use aggressive cleansers.

The remaining instructions in this section are for practitioner use only.

This maintenance must be carried out only by competent personnel (practitioner or suitable trained technician).

The following routine maintenance is to be carried out at least annually:

- Check the securing screws and locking screws for tightness. If loose, remove and clean, then apply Loctite 243 and tighten to the correct torque setting, see *Construction* section.
- Check for defects that could affect proper function.

Ensure the user has read and understood all safety and user-level maintenance information.

Advise the user that a regular visual check of the device is recommended and signs of wear that may affect function should be reported to their service provider (e.g. significant wear or corrosion).

Advise the user to inform the practitioner/service provider of any changes in body weight and/or activity level.

If this device is used for extreme activity, the maintenance level and interval should be reviewed and if required advice and technical support sought to plan a new maintenance schedule dependent upon the frequency and nature of the activity. This should be determined by a local risk assessment carried out by a suitably qualified individual.

6 Limitations on Use

Intended Life

A local risk assessment should be carried out based upon activity and usage.

Lifting Loads

User weight and activity is governed by the stated limits.

Load carrying by the user should be based on a local risk assessment.

Environment

This device can be used as a shower prosthesis but is not designed for prolonged submersion in water. If this device comes into contact with salt or chlorinated water, it should be rinsed with fresh water and dried. Light surface corrosion will not affect the function or security of this device. However, if heavy corrosion is evident, stop using this device and contact your practitioner.

Exclusively for use between -15 °C and 50 °C (5 °F to 122 °F).



Suitable for shower use

7 Assembly and Alignment


The instructions in this section are for practitioner use only.

Adjust alignment of components to optimize function and comfort. Position as close as practical to the build line.

Dynamic Pylon





938306

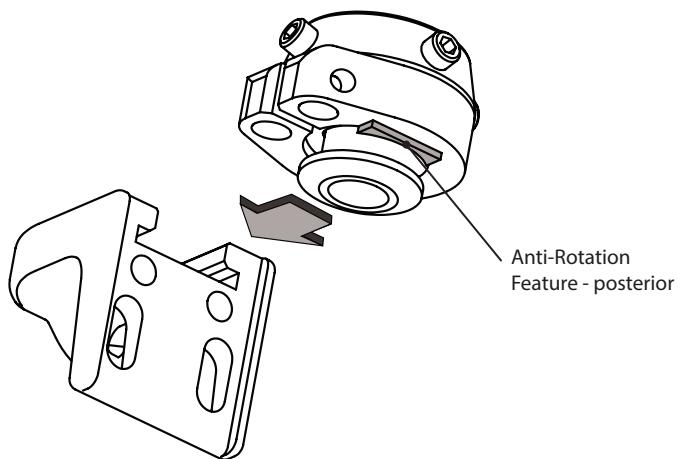

Mercury Knee





938251

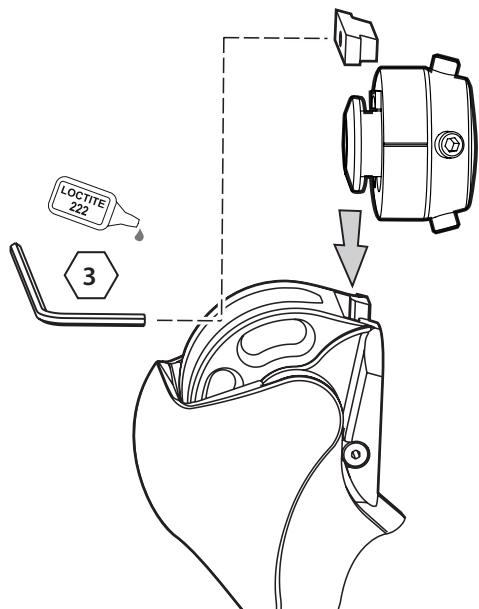

ESK+ 4 Bolt Chassis



938205

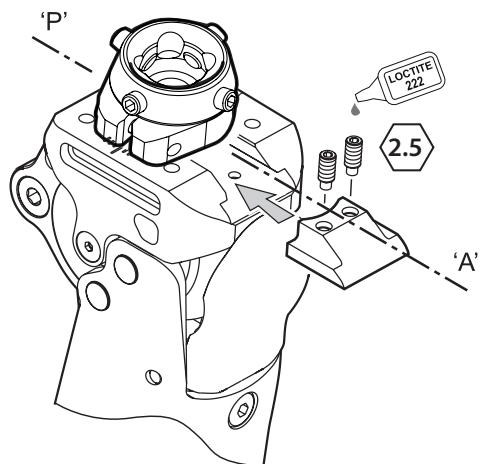



Linx, Orion3



938353





938374

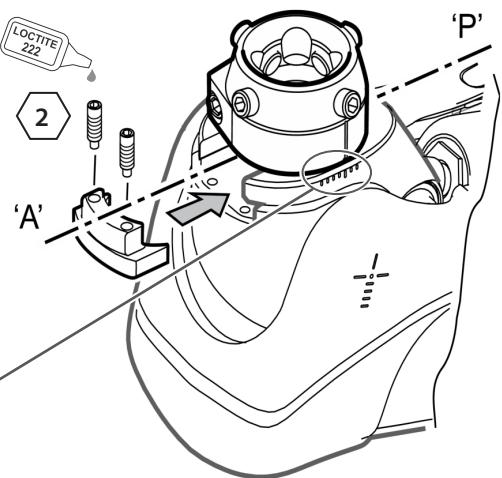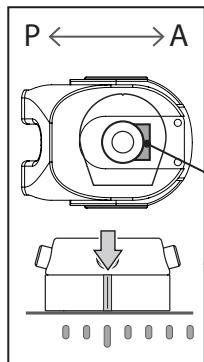

KX06V2



938409

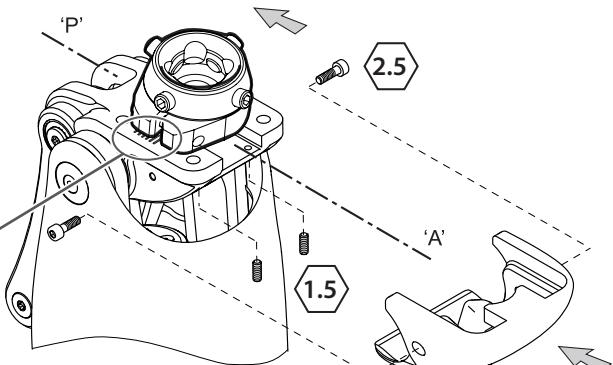


8 Technical Data

Operating and Storage Temperature Range:	-15 °C to 50 °C (5 °F to 122 °F)
Component Weight:	114 g (4 oz)
Activity Level:	1–4
Maximum User Weight:	166 kg (366 lb)
Build Height:	28 mm
Attachment Type:	Distal—Slotted Chassis or Top Housing Proximal—Female Pyramid (Blatchford)
Range of Adjustment:	360° rotation ±7° tilt from vertical
A-P Shift:	15 mm (Dynamic Pylon) 15 mm (Mercury Knee) 6 mm (ESK+ 4 Bolt Chassis) 8 mm (Linx, Orion3) 15 mm (KX06V2)

Build Height

The height of the device is fixed.

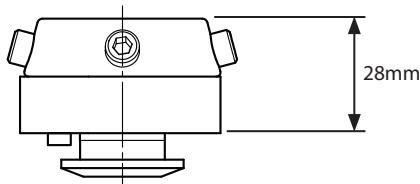

Storage and Handling

When storing for prolonged periods, ensure the product is free from moisture and stored at room temperature.

9 Ordering Information

Device	Part Number
Female Shifting Pyramid Adapter	189128

Liability

The manufacturer recommends using the device only under the specified conditions and for the intended purposes. The device must be maintained according to the instructions for use supplied with the device. The manufacturer is not liable for any adverse outcome caused by any component combinations that were not authorized by them.

CE Conformity

This product meets the requirements of the European Regulation EU 2017/745 for medical devices. This product has been classified as a class I device according to the classification rules outlined in Annex VIII of the regulation. The EU declaration of conformity certificate is available at the following internet address: www.blatchford.co.uk



Medical Device



Single Patient – multiple use

Compatibility

Combination with Blatchford branded products is approved based on testing in accordance with relevant standards and the MDR including structural test, dimensional compatibility and monitored field performance.

Combination with alternative CE marked products must be carried out in view of a documented local risk assessment carried out by a Practitioner.

Warranty

This device is warranted for 24 months.

The user should be aware that changes or modifications not expressly approved could void the warranty, operating licenses and exemptions.

See the Blatchford website for the current full warranty statement.

Reporting of Serious Incidents

In the unlikely event of a serious incident occurring in relation to this device it should be reported to the manufacturer and your national competent authority.

Environmental Aspects

This product is made from a recyclable material. Where possible, the components should be recycled in accordance with local waste handling regulations.

Retaining the Packaging Label

The practitioner is advised to keep the packaging label as a record of the device supplied.

Trademark Acknowledgements

Blatchford is a registered trademark of Blatchford Products Limited.

Manufacturer's Registered Address

Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK.

Table des matières

FR

Table des matières	12
1 Description et objectif visé	13
2 Informations de sécurité.....	14
3 Construction	15
4 Fonction.....	16
5 Entretien.....	16
6 Limites d'utilisation	17
7 Montage et alignement.....	17
8 Données techniques	20
9 Pour commander.....	20

1 Description et objectif visé

Ces instructions d'utilisation sont destinées au praticien et à l'utilisateur, sauf indication contraire.

Le terme *dispositif* est utilisé pour se référer à l'adaptateur pyramidal femelle à translation.

Veuillez lire et vous assurer que vous comprenez toutes les présentes instructions d'utilisation, en particulier les informations de sécurité et les instructions relatives à l'entretien.

Application

Ce dispositif est destiné exclusivement aux prothèses modulaires de membres inférieurs, pour un utilisateur unique.

Ce dispositif est conçu pour connecter un châssis ou un boîtier supérieur à rainure Blatchford à extrémité ouverte à un récepteur pyramidal mâle. Cela permet un réglage de la translation, de l'angle et de la rotation entre les deux parties du membre.

Caractéristiques

- Construction légère et solide en titane et aluminium

Niveau d'activité

Ce dispositif convient aux niveaux d'activité 1 à 4 (des limites de poids s'appliquent, voir *Données techniques*). Bien sûr, il y a des exceptions et, dans notre recommandation, nous souhaitons tenir compte des circonstances uniques et individuelles. Ainsi, toute décision de ce type doit être prise avec une justification solide et approfondie.

Activité de niveau 1

A la possibilité ou le potentiel d'utiliser une prothèse pour les transferts ou déplacements sur des surfaces planes à une cadence fixe. Caractéristiques du patient domestique limité et illimité.

Activité de niveau 2

A une capacité ou un potentiel de déambulation avec possibilité de gérer des obstacles environnementaux bas tels que les trottoirs, les escaliers ou les surfaces inégales. Caractéristique du patient limité en extérieur.

Activité de niveau 3

A une capacité ou un potentiel de déplacement à cadence variable. Typique du patient en extérieur qui a la capacité de franchir la plupart des barrières environnementales et peut avoir une activité professionnelle, thérapeutique ou physique qui exige l'utilisation de prothèses au-delà de la simple locomotion.

Activité de niveau 4

A une capacité ou un potentiel de déplacement prothétique qui dépasse les capacités de déplacement de base, présentant des niveaux d'impact, de contrainte ou d'énergie élevés. Typique des exigences prothétiques de l'enfant, de l'adulte actif ou du sportif.

Contre-indications

Il n'y a pas de contre-indications connues si le produit est utilisé conformément aux présentes instructions.

Avantages cliniques

Assure une connexion entre les composants prothétiques qui permet un certain ajustement de l'alignement.

2 Informations de sécurité



Ce symbole d'avertissement met en évidence des informations de sécurité importantes qui doivent être scrupuleusement respectées.



Tout changement dans la performance ou la fonction du membre, par exemple un mouvement excessif ou des bruits inhabituels, doit être immédiatement signalé à votre prestataire de services.



Servez-vous toujours d'une rampe pour descendre les escaliers et à tout autre moment si possible.



Le dispositif peut être utilisé comme prothèse de douche mais n'est pas conçu pour une immersion prolongée dans l'eau. Essuyez immédiatement après tout contact avec l'eau. Si ce dispositif entre en contact avec de l'eau salée ou chlorée, il doit être rincé à l'eau douce, puis séché. Veiller à ce que toute utilisation du dispositif dans l'eau soit conforme aux conditions énoncées au paragraphe *Limites d'utilisation*.



Seul un praticien dûment qualifié peut procéder au montage, à l'entretien et à la réparation du dispositif.



L'utilisateur ne doit pas régler ou modifier la configuration du dispositif.



Il est conseillé au patient de contacter son praticien si son état vient à changer.



Pour réduire les risques de blessures liées à la défaillance ou au desserrage des assemblages par boulons, veillez à ce que les filets des boulons soient soigneusement nettoyés avant chaque installation.




Serrez toujours les vis au couple spécifié.

3 Construction

Composants principaux

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| • Pyramide femelle | Titane |
| • Collier/Collier de serrage | Alliage d'aluminium |
| • Vis de pression de pyramide | Acier plaqué (x4) |
| • Vis de blocage et inserts | Acier plaqué |

Identification des composants

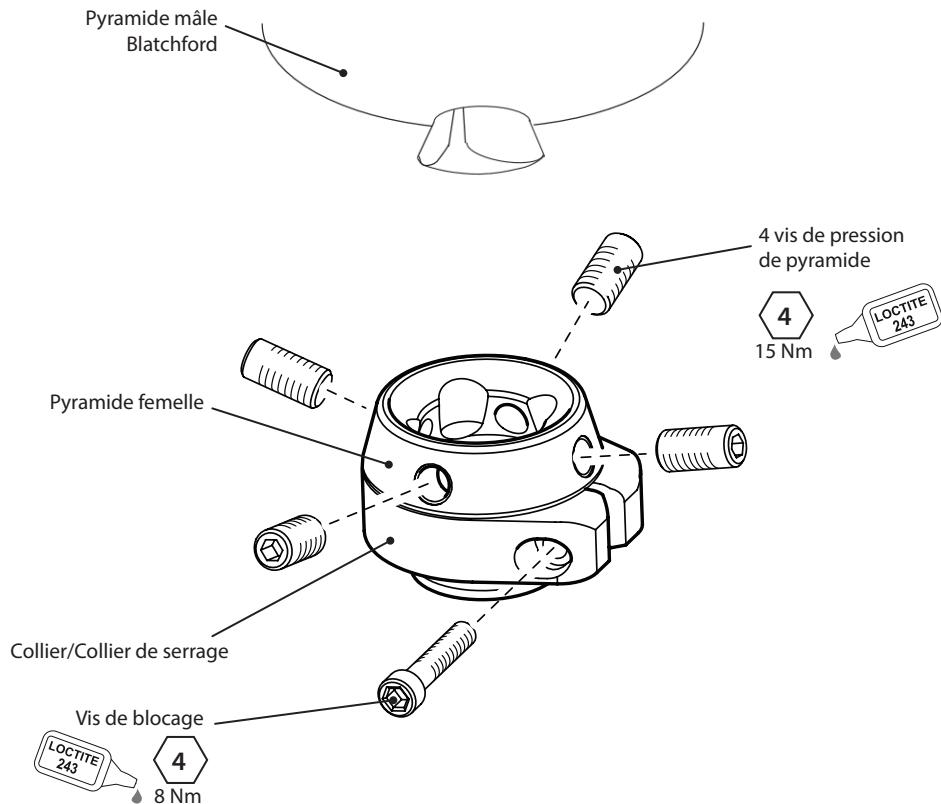

4 Fonction

Ce dispositif est constitué de deux composants principaux. Le mouvement entre ces deux composants avant le serrage des vis pyramidales et de la vis de serrage permet d'aligner le membre en fonction de l'utilisateur. Une fois bien serré, à l'aide de Loctite 243 et des réglages de couple indiqués, le dispositif assure une connexion fiable entre les deux parties du membre.

5 Entretien

Vérifiez visuellement le dispositif à intervalles réguliers.

Signalez au praticien/prestataire de services tout changement dans les performances de ce dispositif, par exemple bruits ou mouvements inhabituels ou usure importante.

Informez le praticien/prestataire de service de tout changement de poids corporel et/ou de niveau d'activité.

Nettoyage

Utilisez un chiffon humide et du savon doux pour nettoyer les surfaces extérieures. N'UTILISEZ PAS de détergents agressifs.

Les autres instructions de cette section sont destinées à être utilisées par des praticiens.

Cet entretien doit être effectué uniquement par un personnel compétent (praticien ou technicien qualifié).

L'entretien régulier suivant doit être effectué au moins une fois par an :

- Vérifiez que les vis de fixation et les vis de blocage sont bien serrées. Si elles sont desserrées, retirez-les et nettoyez-les, puis appliquez du Loctite 243 et serrez-les au couple de serrage correct, voir la section *Construction*.
- Vérifiez la présence de défauts susceptibles d'affecter le bon fonctionnement.

Assurez-vous que l'utilisateur a lu et compris toutes les informations relatives à la sécurité et à l'entretien à réaliser par l'utilisateur.

Conseillez à l'utilisateur de procéder à un examen visuel régulier du dispositif et de signaler à son prestataire de services les signes d'usure susceptibles d'affecter le fonctionnement (par exemple, usure ou corrosion importante).

Conseillez à l'utilisateur d'informer le praticien/prestataire de service de tout changement de poids corporel et/ou de niveau d'activité.

Si ce dispositif est utilisé pour une activité extrême, le niveau et l'intervalle d'entretien doivent être revus et, si nécessaire, des conseils et une assistance technique doivent être recherchés pour planifier un nouveau calendrier d'entretien en fonction de la fréquence et de la nature de l'activité. Cela doit être déterminé dans le cadre d'une évaluation locale des risques menée par une personne dûment qualifiée.

6 Limites d'utilisation

Durée de vie prévue

Une évaluation locale des risques doit être effectuée sur la base de l'activité et de l'utilisation.

Soulever des charges

Le poids et l'activité de l'utilisateur sont régis par les limites indiquées.

Le transport de charges par l'utilisateur doit être basé sur une évaluation locale des risques.

Environnement

Ce dispositif peut être utilisé comme prothèse de douche mais n'est pas conçu pour une immersion prolongée dans l'eau. Si ce dispositif entre en contact avec de l'eau salée ou chlorée, il doit être rincé à l'eau douce, puis séché. Une légère corrosion de surface n'affectera pas le fonctionnement ou la sécurité de ce dispositif. Cependant, si une forte corrosion est évidente, arrêtez d'utiliser ce dispositif et contactez votre praticien.

Pour une utilisation exclusivement entre -15 °C et 50 °C.



Convient pour la douche

7 Montage et alignement

Les instructions de cette section sont destinées à être utilisées par des praticiens.


Ajustez l'alignement des composants pour optimiser le fonctionnement et le confort.

La position doit être aussi proche que possible de l'axe de construction.

Tube dynamique




938306

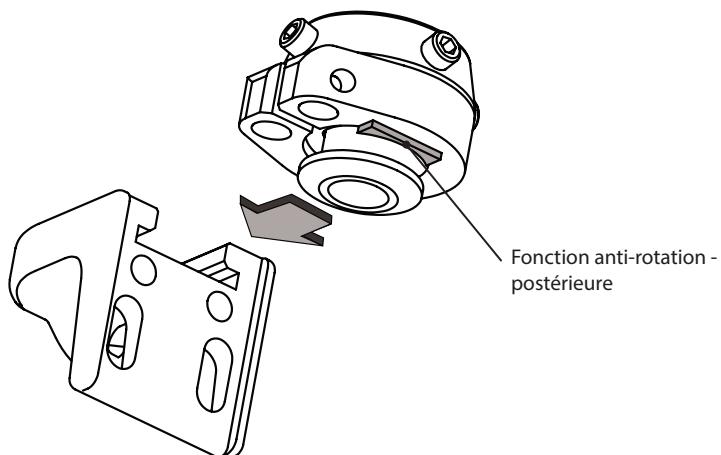


Genou Mercury



938251




Fonction
anti-rotation -
antérieure

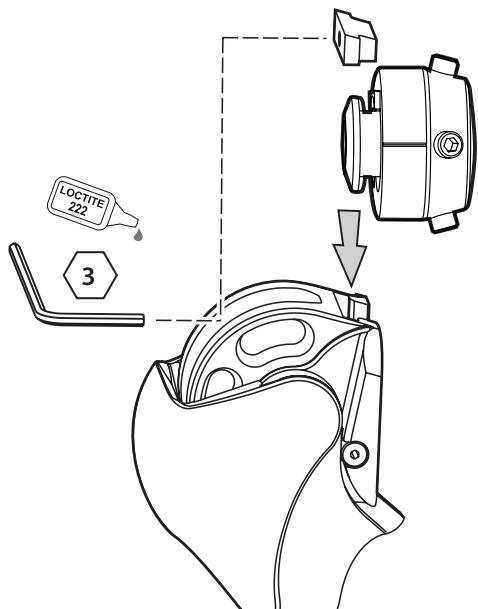


Châssis à 4 boulons ESK+



938205



Fonction
anti-rotation -
antérieure

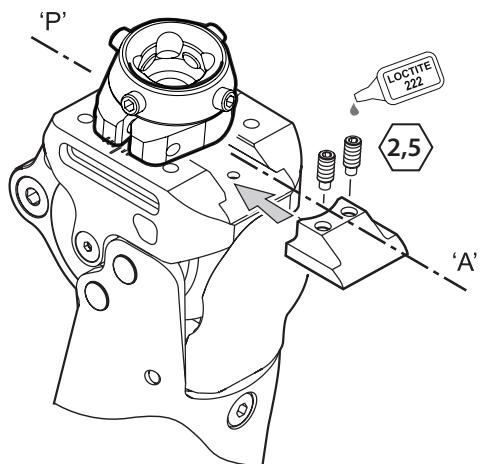


Linx, Orion3




938353



938374

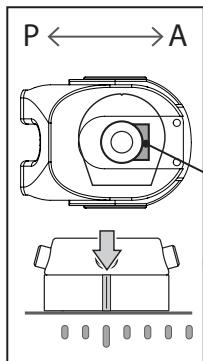


Fonction
anti-rotation -
antérieure

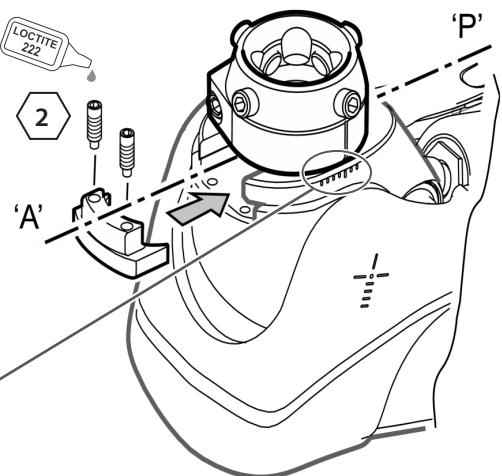


KX06V2



938409



Fonction
anti-rotation -
antérieure

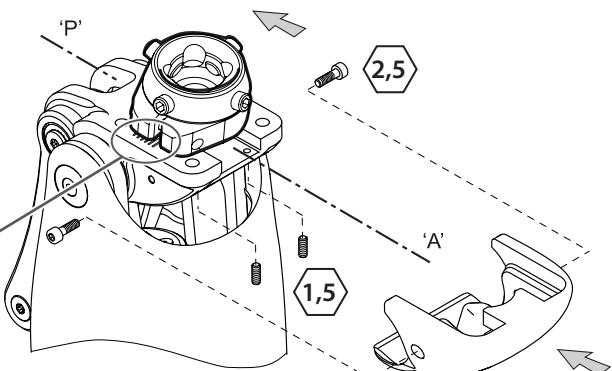


8 Données techniques

Plage de température de fonctionnement et de stockage :	-15 °C à 50 °C
Poids de l'élément :	114 g
Niveau d'activité :	1-4
Poids maximum de l'utilisateur :	166 kg
Hauteur de construction :	28 mm
Type de fixation :	Distal - Châssis ou un boîtier supérieur à rainure Proximal - Pyramide femelle (Blatchford)
Plage d'ajustement :	Rotation à 360° ±7° d'inclinaison par rapport à la verticale
Translation A-P :	15 mm (Tube dynamique) 15 mm (Genou Mercury) 6 mm (Châssis à 4 boulons ESK+) 8 mm (Linx, Orion3) 15 mm (KX06V2)

Hauteur de construction

La hauteur du dispositif est fixe.

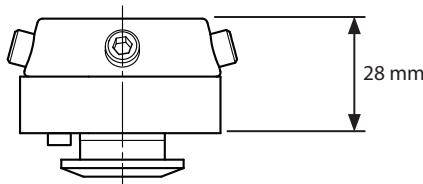

Stockage et manipulation

En cas de stockage prolongé, veillez à ce que le produit soit exempt d'humidité et conservé à température ambiante.

9 Pour commander

Dispositif	Référence
Adaptateur pyramidal femelle à translation	189128

Responsabilité

Le fabricant recommande d'utiliser le dispositif uniquement dans les conditions spécifiées et pour les usages prévus. Le dispositif doit être entretenu conformément au mode d'emploi fourni avec ce dernier. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences négatives causées par des combinaisons de composants qu'il n'a pas lui-même autorisées.

Conformité CE

Ce produit répond aux exigences du règlement européen UE 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. Ce produit a été classé comme dispositif de classe I selon les règles de classification énoncés à l'Annexe VIII de la réglementation. Le certificat de déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.blatchford.co.uk



Dispositif médical



Patient unique - usage multiple

Compatibilité

La combinaison avec des produits de la marque Blatchford est approuvée sur la base d'essais conformes aux normes pertinentes et au règlement relatif aux dispositifs médicaux (RDM), y compris les essais structurels, la compatibilité dimensionnelle et le contrôle des performances sur le terrain.

La combinaison avec d'autres produits marqués CE doit être effectuée en vue d'une évaluation locale des risques documentée, effectuée par un praticien.

Garantie

Ce dispositif est garanti 24 mois.

L'utilisateur doit savoir que des changements ou des modifications non expressément approuvés peuvent annuler la garantie, les licences d'exploitation et les exemptions.

Consultez le site web de Blatchford pour obtenir la déclaration de garantie complète actuelle.

Signalement des incidents graves

Dans le cas peu probable où un incident grave surviendrait en rapport avec ce dispositif, il doit être signalé au fabricant et à votre autorité nationale compétente.

Aspects environnementaux

Ce produit est fabriqué à partir d'un matériau recyclable. Dans la mesure du possible, les composants doivent être recyclés conformément aux réglementations locales en matière de traitement des déchets.

Conserver l'étiquette de l'emballage

Il est conseillé au praticien de conserver l'étiquette de l'emballage comme trace du dispositif fourni.

Reconnaissance des marques

Blatchford est une marque déposée de Blatchford Products Limited.

Siège social du fabricant

Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, Royaume-Uni

Inhalt.....	22
1 Beschreibung und Verwendungszweck	23
2 Sicherheitsinformationen	24
3 Aufbau.....	25
4 Funktion.....	26
5 Wartung.....	26
6 Verwendungseinschränkungen.....	27
7 Zusammenbau und Ausrichtung	27
8 Technische Daten.....	30
9 Bestellinformationen	30

1 Beschreibung und Verwendungszweck

Diese Gebrauchsanweisung ist für die Verwendung durch Fachpersonal und Anwender konzipiert, außer anderweitig angegeben.

Der Begriff *Produkt* wird in diesem Dokument durchgängig verwendet und bezieht sich auf den beweglichen Pyramidenaufnahmedapter.

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie diese Gebrauchsanweisung gelesen und verstanden haben, insbesondere alle Anweisungen zu Sicherheit und Wartung.

Anwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich als Teil einer modularen Prothese der unteren Extremität und für einen einzelnen Anwender vorgesehen.

Das Produkt dient zur Verbindung einer geschlitzten Blatchford Chassis mit offenem Ende oder eines oberen Gehäuses mit einer Pyramidenaufnahme. Dies ermöglicht Bewegung sowie anguläre und rotationale Einstellung zwischen den beiden Prothesenteilen.

Eigenschaften

- Leicht und widerstandsfähig aus Titan und Aluminium

Mobilitätsklasse

Dieses Produkt eignet sich für die Mobilitätsklassen 1 bis 4 (es gelten Gewichtsbeschränkungen, siehe *Technische Daten*). Natürlich gibt es Ausnahmen, und wir möchten in unseren Empfehlungen Raum für einzigartige, individuelle Umstände lassen. Daher sollten derartige Entscheidungen mit vernünftiger und durchdachter Begründung erfolgen.

Mobilitätsklasse 1

Hat die Fähigkeit oder das Potenzial, eine Prothese bei Transfers oder beim Gehen auf ebenem Untergrund bei fester Schrittfréquenz zu nutzen. Typisch für Personen mit begrenzter oder unbegrenzter Mobilität im Haushalt.

Mobilitätsklasse 2

Hat die Fähigkeit oder das Potenzial für Mobilität mit der Möglichkeit, niedrige Hindernisse in der Umwelt zu überwinden, beispielsweise Bordsteinkanten, Treppen oder unebenen Untergrund. Typisch für Personen mit begrenzter Mobilität in der Gesellschaft.

Mobilitätsklasse 3

Hat die Fähigkeit oder das Potenzial, Mobilität mit variabler Schrittfréquenz zu erreichen. Typisch für allgemein mobile Personen mit der Fähigkeit, die meisten Hindernisse in der Umgebung zu überwinden, und mit beruflicher, therapeutischer oder sportlicher Betätigung, die eine Nutzung der Prothese über einfache Fortbewegung hinaus erfordert.

Mobilitätsklasse 4

Mit der Möglichkeit oder dem Potenzial für prosthetische Mobilisierung, die über grundlegende Mobilisierung hinausgeht und starke Stöße, hohe Belastungen oder hohe Energiedurchwirkung umfasst. Typisch für die prosthetischen Anforderungen von Kindern, aktiven Erwachsenen oder Sportlern.

Gegenanzeigen

Es gibt keine bekannten Gegenanzeigen, wenn das Produkt entsprechend dieser Anweisungen verwendet wird.

Klinischer Nutzen

Schafft eine Verbindung zwischen Prothetikkomponenten, die eine gewisse Anpassung der Ausrichtung ermöglicht.

2 Sicherheitsinformationen


-  **Das Warnsymbol hebt wichtige Sicherheitsinformationen hervor, die genau befolgt werden müssen.**
-  **Sämtliche Veränderungen in der Leistung oder Funktion der Extremität, wie z. B. übermäßiges Spiel oder ungewöhnliche Geräusche, sollten Sie sofort Ihrem Dienstleister mitteilen.**
-  **Benutzen Sie beim Treppabgehen oder in ähnlichen Situationen immer ein Geländer (falls vorhanden).**
-  **Das Produkt kann als Duschprothese verwendet werden, eignet sich allerdings nicht für längeres Untertauchen in Wasser. Nach Kontakt mit Wasser unverzüglich trocken wischen. Falls das Produkt in Kontakt mit Salzwasser oder chlorhaltigem Wasser kommt, muss es mit Süßwasser abgespült und getrocknet werden. Stellen Sie sicher, dass jede Verwendung des Produkts in Wasser den Bedingungen in Verwendungseinschränkungen entspricht.**
-  **Montage und Reparatur des Produkts dürfen nur von ausreichend qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.**
-  **Der Anwender darf die Einstellung des Produkts nicht verändern oder manipulieren.**
-  **Der Anwender muss sein Fachpersonal kontaktieren, wenn sich sein Zustand verändert.**
-  **Zur Reduzierung des Verletzungsrisikos aufgrund von versagenden oder lockeren Schraubverbindungen stellen Sie bitte sicher, dass die Bolzengewinde vor jeder Installation gründlich gereinigt wurden.**
-  **Ziehen Sie die Schrauben stets mit dem angegebenen Drehmoment fest.**

3 Aufbau

Hauptteile

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| • Pyramidenaufnahme | Titan |
| • Kragen/Klemmenring | Aluminiumlegierung |
| • Pyramiden-Stellschrauben | beschichteter Stahl (4 x) |
| • Klemmschraube und Einsätze | beschichteter Stahl |

Komponentenidentifikation

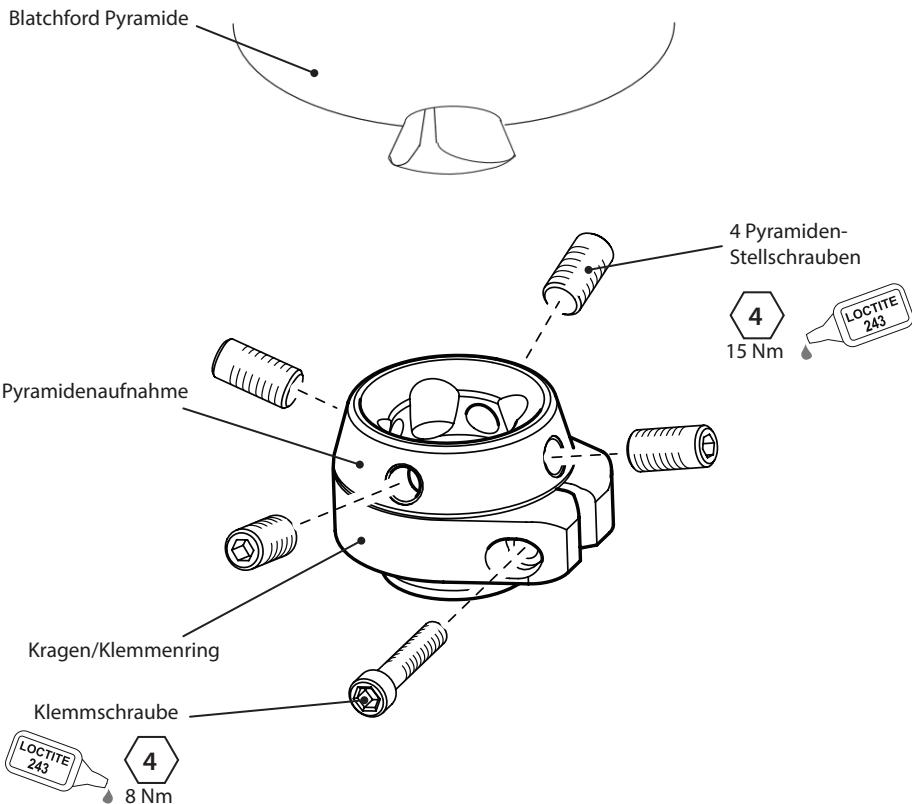

4 Funktion

Das Produkt besteht aus zwei Hauptkomponenten. Die Bewegung zwischen diesen beiden Komponenten vor Anziehen der Pyramidenschrauben und Klemmschraube ermöglicht die Ausrichtung der Prothese entsprechend dem jeweiligen Anwender. Werden die Schrauben sicher mit Loctite 243 und dem angegebenen Drehmoment angezogen, ermöglicht dieses Produkt eine sichere Verbindung von zwei Prothesenteilen.

5 Wartung

Führen Sie regelmäßig eine Sichtprüfung des Produkts durch.

Melden Sie dem Fachpersonal/Dienstleister jegliche Veränderungen der Produktleistung, z. B. ungewöhnliche Geräusche, Spiel oder deutlichen Verschleiß.

Informieren Sie die Fachkraft oder den Dienstleister über Veränderungen des Körpergewichts und/oder Aktivitätsniveaus.

Reinigung

Reinigen Sie die äußereren Oberflächen mit einem feuchten Tuch und milder Seife. Verwenden Sie KEINE aggressiven Reiniger.

Die übrigen Anweisungen in diesem Abschnitt richten sich ausschließlich an Fachpersonal.

Diese Wartung darf nur von kompetenten Personen (Techniker oder ausreichend geschultes Fachpersonal) durchgeführt werden.

Die folgenden Wartungsmaßnahmen sind mindestens jährlich vorzunehmen:

- Prüfen Sie die Sicherungs- und Verriegelungsschrauben auf festen Sitz. Sind sie locker, entfernen und reinigen Sie sie, tragen Sie Loctite 243 auf und ziehen Sie die Schrauben mit dem korrekten Drehmoment fest, siehe Abschnitt Aufbau.
- Prüfen Sie das Produkt auf Defekte, die die korrekte Funktion beeinträchtigen könnten.

Stellen Sie sicher, dass der Anwender alle Sicherheits- und Wartungsinformationen für Anwender gelesen und verstanden hat.

Weisen Sie den Anwender darauf hin, dass eine regelmäßige Sichtprüfung des Produktes empfohlen wird und dass Anzeichen von Verschleiß, der die Funktion beeinträchtigen könnte (z. B. deutlicher Verschleiß oder Korrosion), dem Dienstleister mitgeteilt werden müssen.

Weisen Sie den Anwender darauf hin, die Fachkraft oder den Dienstleister über Veränderungen des Körpergewichts und/oder Aktivitätsniveaus zu informieren.

Wenn dieses Produkt für extreme Aktivitäten verwendet wird, müssen das Wartungsniveau und -intervall geprüft und bei Bedarf technische Unterstützung und Beratung eingeholt werden, damit ein neuer Wartungsplan entsprechend der Häufigkeit und Art der Aktivitäten erstellt werden kann. Dies sollte anhand einer lokalen Risikobeurteilung erfolgen, die von einer qualifizierten Person durchgeführt wird.

6 Verwendungseinschränkungen

Vorgesehene Lebensdauer

Es sollte eine lokale Risikobeurteilung basierend auf Mobilität und Nutzung durchgeführt werden.

Heben von Lasten

Das Gewicht und die Mobilität des Anwenders werden von den angegebenen Grenzwerten bestimmt.

In einer lokalen Risikobewertung sollte ermittelt werden, wie viel Last der Anwender tragen kann.

Umwelt

Dieses Produkt kann als Duschprothese verwendet werden, eignet sich allerdings nicht für längeres Untertauchen in Wasser. Falls das Produkt in Kontakt mit Salzwasser oder chlorhaltigem Wasser kommt, muss es mit Süßwasser abgespült und getrocknet werden. Eine leichte Korrosion der Oberfläche beeinträchtigt nicht die Funktion oder Sicherheit des Produkts. Ist jedoch starke Korrosion sichtbar, verwenden Sie das Produkt nicht länger und wenden sich an Ihre Fachkraft.

Das Produkt ist nur für die Nutzung bei Temperaturen zwischen -15 °C und 50 °C vorgesehen.




Geeignet für die Verwendung in der Dusche

7 Zusammenbau und Ausrichtung


Die Anweisungen in diesem Abschnitt richten sich ausschließlich an Fachpersonal.

Passen Sie die Ausrichtung der Komponenten für optimale Funktion und Komfort an.
Positionieren Sie das Produkt so nahe wie möglich an der Lotlinie.

Dynamischer Pylon




938306

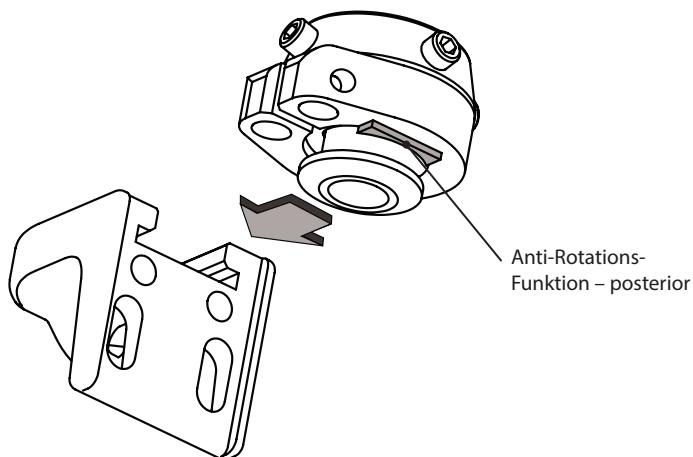


Mercury Knie



938251




Anti-Rotations-
Funktion –
anterior

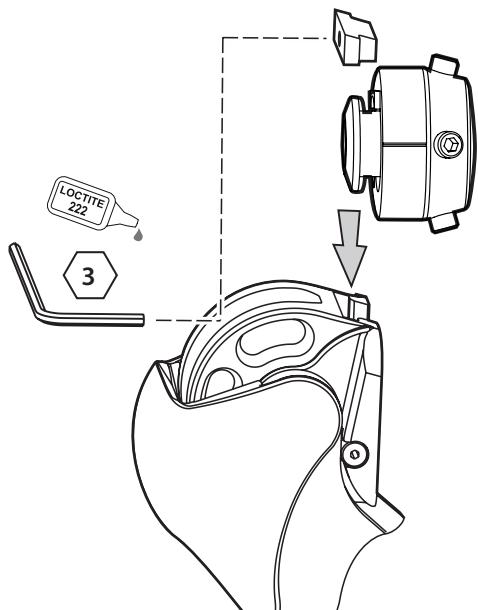


ESK+ 4-Schrauben-Chassis



938205



Anti-Rotations-
Funktion –
anterior

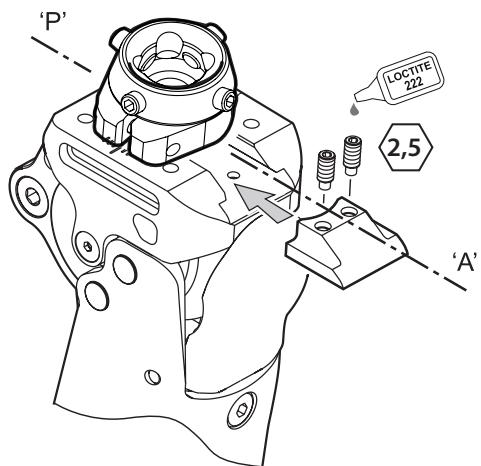


Linx, Orion3




938353



938374

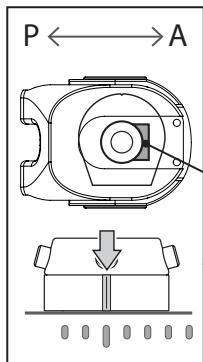


Anti-Rotations-Funktion – anterior

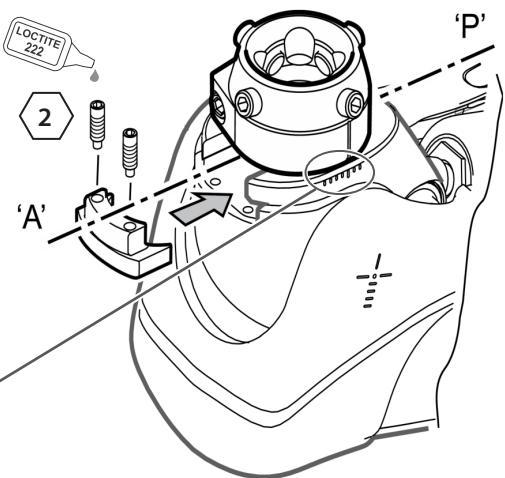


KX06V2



938409



Anti-Rotations-Funktion – anterior

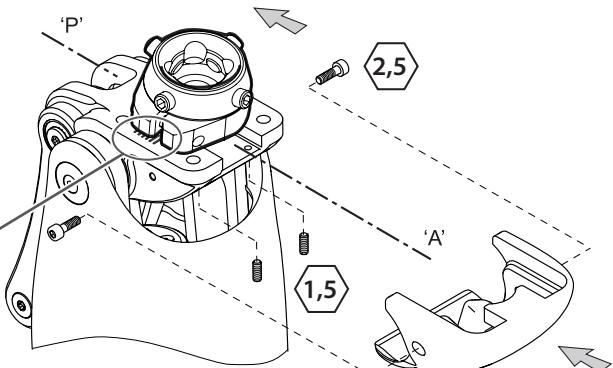


8 Technische Daten

Temperaturbereich für Betrieb und Lagerung:	-15 °C bis 50 °C
Komponentengewicht:	114 g
Mobilitätsklasse:	1–4
Maximales Anwendergewicht:	166 kg
Aufbauhöhe:	28 mm
Befestigungstyp:	Distal – geschlitzte Chassis für oberes Gehäuse Proximal – Pyramidenaufnahme (Blatchford)
Einstellbereich:	360° Rotation ±7° Neigung von vertikal
A-P-Bewegung:	15 mm (dynamischer Pylon) 15 mm (Mercury Knie) 6 mm (ESK+ 4-Schrauben-Chassis) 8 mm (Linx, Orion3) 15 mm (KX06V2)

Aufbauhöhe

Die Produkthöhe ist fest.

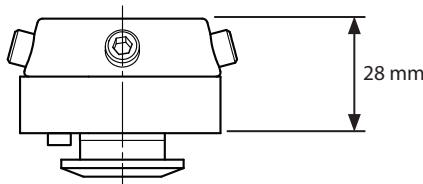

Aufbewahrung und Handhabung

Zur Aufbewahrung über einen längeren Zeitraum muss das Produkt frei von Feuchtigkeit sein und bei Raumtemperatur gelagert werden.

9 Bestellinformationen

Produkt	Artikelnummer
Beweglicher Pyramidenaufnahmehandler	189128

Haftung

Der Hersteller empfiehlt, das Produkt nur unter den angegebenen Bedingungen und für die angegebenen Zwecke zu verwenden. Das Produkt muss entsprechend der mit dem Produkt gelieferten Gebrauchsanweisung gewartet werden. Der Hersteller haftet nicht für nachteilige Ergebnisse, die durch nicht autorisierte Komponentenkombinationen entstanden sind.

CE-Konformität

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie EU 2017/745 für Medizinprodukte. Dieses Produkt wurde entsprechend den Klassifizierungskriterien in Anhang VIII der Richtlinie als Produkt der Klasse I klassifiziert. Das Zertifikat der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.blatchford.co.uk



Medizinprodukt



Ein Patient – Mehrfachverwendung

Kompatibilität

Die Kombination mit Produkten der Marke Blatchford ist zulässig basierend auf Tests gemäß den geltenden Normen und der MDR mit strukturellen Tests, dimensionaler Kompatibilität und überwachter Praxisleistung.

Die Kombination mit alternativen, CE-gekennzeichneten Produkten darf nur nach einer dokumentierten lokalen Risikobeurteilung durch eine Fachkraft erfolgen.

Garantie

Das Produkt verfügt über eine Garantie von 24 Monaten.

Der Anwender muss sich bewusst sein, dass nicht ausdrücklich genehmigte Änderungen oder Modifikationen zum Verfall der Garantie, Betriebsgenehmigung und Ausnahmen führen können.

Auf der Blatchford-Website finden Sie die aktuellen detaillierten Garantiebedingungen.

Bericht schwerer Zwischenfälle

Im unwahrscheinlichen Fall eines schweren Zwischenfalls in Verbindung mit diesem Produkt muss der Zwischenfall dem Hersteller und der für Ihr Land zuständigen Behörde gemeldet werden.

Umweltaspekte

Dieses Produkt besteht aus recycelbarem Material. Wenn möglich, sollten die Komponenten entsprechend den vor Ort geltenden Abfallvorschriften recycelt werden.

Aufbewahrung des Verpackungsetiketts

Die Fachkraft sollte das Verpackungsetikett als Aufzeichnung zum gelieferten Produkt aufbewahren.

Hinweise zu Handelsmarken

Blatchford ist eine eingetragene Marke von Blatchford Products Limited.

Eingetragene Adresse des Herstellers

Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, Vereiniges Königreich.

Indice	32
1 Descrizione e finalità	33
2 Informazioni sulla sicurezza	34
3 Struttura.....	35
4 Funzionamento.....	36
5 Manutenzione	36
6 Limiti di utilizzo.....	37
7 Montaggio ed allineamento	37
8 Dati tecnici.....	40
9 Informazioni sulle ordinazioni.....	40

1 Descrizione e finalità

Le presenti istruzioni per l'uso sono destinate ai tecnici ortopedici e ai pazienti, fatto salvo quanto diversamente specificato.

Il termine *dispositivo* è utilizzato in questo documento per fare riferimento al raccordo traslatore con piramide femmina.

Si prega di leggere e accertarsi di avere compreso le istruzioni, in particolare tutte le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni sulla manutenzione.

Applicazione

Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente per protesi modulari di arto inferiore. Prodotto destinato all'utilizzo da parte di un solo paziente.

Il dispositivo è studiato per collegare un telaio Blatchford con scanalature o con alloggiamento superiore ad una piramide maschio, consentendo lo scorrimento e la regolazione angolare e rotazionale tra le due parti.

Caratteristiche

- Struttura leggera, resistente, in titanio e alluminio

Livello di attività

Il dispositivo è adatto per livelli di attività compresi tra 1 e 4 (si applicano limiti di peso, consultare la sezione *Dati tecnici*). Naturalmente vi sono delle eccezioni e nella nostra raccomandazione vogliamo consentire circostanze uniche e individuali e qualsiasi decisione di questo tipo dovrebbe essere presa con una motivazione solida e approfondita.

Livello di attività 1

Ha la capacità o la potenzialità di usare una protesi per il passaggio o la deambulazione su superfici piane a cadenza fissa. Situazione tipica del paziente che deambula all'interno della propria abitazione in modo limitato o illimitato.

Livello di attività 2

Ha la capacità o la potenzialità di deambulare riuscendo a superare barriere architettoniche di basso livello quali marciapiedi, scale o superfici irregolari. Situazione tipica del paziente che deambula fuori dalla propria abitazione in modo limitato.

Livello di attività 3

Ha la capacità o il potenziale per deambulare con cadenza variabile. Situazione tipica del paziente che deambula fuori dalla propria abitazione, che è in grado di superare la maggior parte delle barriere architettoniche e che può svolgere attività professionali, terapeutiche o fisiche che richiedono l'uso di protesi al di là della semplice deambulazione.

Livello di attività 4

Il paziente riesce o ha una potenziale capacità di deambulazione protesica che supera le abilità di deambulazione di base, dimostrando impatto, stress o livelli energetici elevati. Situazione tipica delle richieste protesiche del bambino, dell'adulto attivo o dell'atleta.

Controindicazioni

Non sono note controindicazioni se utilizzato in conformità alle presenti istruzioni.

Vantaggio clinico

Garantisce un collegamento tra le componenti protesiche che consentono una regolazione in fase di allineamento.

2 Informazioni sulla sicurezza



Questo simbolo evidenzia importanti informazioni sulla sicurezza che devono essere seguite con attenzione.



Tutte le variazioni delle prestazioni o delle funzionalità dell'arto, ad esempio, gioco eccessivo o rumori insoliti, devono essere segnalate immediatamente al tecnico ortopedico.



Appoggiarsi sempre a un corrimano nella discesa delle scale e in qualsiasi altro momento, se disponibile.



Questo dispositivo può essere utilizzato come protesi per doccia ma non è adatto a immersioni prolungate in acqua. Dopo il contatto con l'acqua, asciugare immediatamente.

Se entra a contatto con acqua salata o clorata, risciacquare con acqua dolce e asciugare. Accertarsi che l'eventuale uso del dispositivo nell'acqua rispetti le condizioni indicate nella sezione *Limits di utilizzo*.



Il montaggio, la manutenzione e la riparazione del dispositivo devono essere eseguiti solo dal personale adeguatamente qualificato.



Il paziente non deve regolare o modificare la configurazione del dispositivo.



In caso di variazione delle condizioni, si raccomanda al paziente di contattare il proprio tecnico ortopedico.



Per ridurre il rischio di lesioni dovute a guasto o allentamento dei collegamenti a vite, assicurarsi di pulire approfonditamente le filettature dei bulloni prima di ogni montaggio.




Applicare sempre ai bulloni il valore di coppia specificato.

3 Struttura

Componenti principali

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| • Piramide femmina | Titanio |
| • Colletto/Anello di chiusura | Lega di alluminio |
| • Viti di fondo corsa della piramide | Acciaio placcato (x4) |
| • Inserti e vite di chiusura | Acciaio placcato |

Identificazione dei componenti

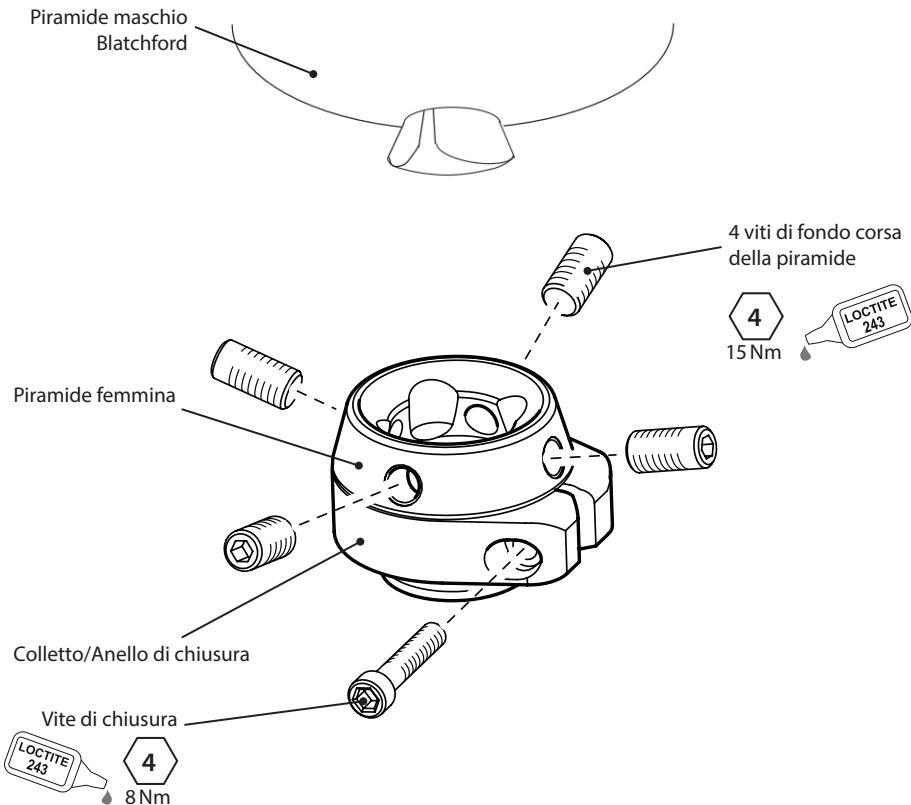

4 Funzionamento

Questo dispositivo comprende due componenti principali. Il movimento tra queste due componenti prima del serraggio dei bulloni della piramide e della vite di chiusura fa sì che l'allineamento del moncone si adatti al singolo utente. Se il bullone di allineamento è serrato saldamente con Loctite 243 e alle coppie di serraggio indicate, il dispositivo garantisce un collegamento sicuro delle due parti del moncone.

5 Manutenzione

Effettuare controlli visivi regolari del dispositivo.

Segnalare al tecnico ortopedico eventuali variazioni della prestazione del dispositivo, ad esempio rumori insoliti o usura o movimento eccessivi.

Informare il tecnico ortopedico di tutti i cambiamenti di peso corporeo e/o del livello di attività.

Pulizia

Pulire le superfici esterne con un panno umido e un detergente neutro. NON utilizzare detergenti aggressivi.

Le restanti istruzioni della presente sezione sono destinate ai soli tecnici ortopedici.

La manutenzione deve essere svolta solo da personale competente (tecnico ortopedico o altro tecnico esperto).

La seguente manutenzione di routine deve essere eseguita annualmente:

- Controllare il serraggio delle viti di sicurezza e delle viti di bloccaggio. In caso contrario, rimuoverle e pulirle, quindi avvitarle alla coppia di serraggio prevista utilizzando Loctite 243, vedi la sezione *Struttura*.
- Controllare la presenza di difetti che possono interferire con il corretto funzionamento.

Assicurarsi che il paziente abbia letto e compreso tutte le informazioni sulla sicurezza e sulla manutenzione da parte del paziente.

Si consiglia all'utente di effettuare un controllo visivo regolare del dispositivo e di segnalare al tecnico eventuali segni di usura che possono compromettere il funzionamento (ad esempio, usura o corrosione eccessive).

Consigliare al paziente di Informare il tecnico ortopedico di tutti i cambiamenti di peso corporeo e/o del livello di attività.

Se il dispositivo viene utilizzato per svolgere attività estreme, occorre rivedere il livello e l'intervallo di manutenzione e, se necessario, richiedere consulenza e supporto tecnico per programmare un nuovo piano di manutenzione a seconda della frequenza e della natura dell'attività. Tale piano dovrebbe essere stabilito da una valutazione del rischio locale eseguita da un operatore adeguatamente qualificato.

6 Limiti di utilizzo

Durata prevista

È necessario effettuare una valutazione del rischio specifica in base all'attività e all'utilizzo del dispositivo.

Sollevamento carichi

Il peso e l'attività del paziente devono rispettare i limiti indicati.

Il peso trasportato dal paziente deve basarsi sulla valutazione del rischio specifico.

Ambiente

Questo dispositivo può essere utilizzato come protesi per doccia ma non è adatto a immersioni prolungate in acqua. Se entra a contatto con acqua salata o clorata, risciacquare con acqua dolce e asciugare. Una leggera corrosione in superficie non compromette il funzionamento o la sicurezza del dispositivo. Tuttavia, se la corrosione è evidente, interrompere l'uso del dispositivo e contattare il tecnico ortopedico.

Utilizzare esclusivamente a temperature comprese tra -15 °C e 50 °C.




Utilizzabile sotto la doccia

7 Montaggio ed allineamento


Le istruzioni della presente sezione sono destinate ai soli tecnici ortopedici.

Regolare l'allineamento dei componenti per ottimizzare la funzionalità e il comfort. Posizionare il più vicino possibile alla linea di costruzione.

Pilone dinamico





938306

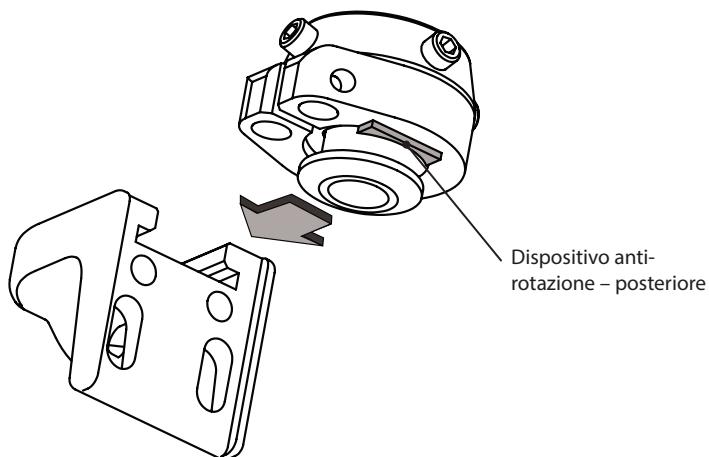

Ginocchio Mercury





938251

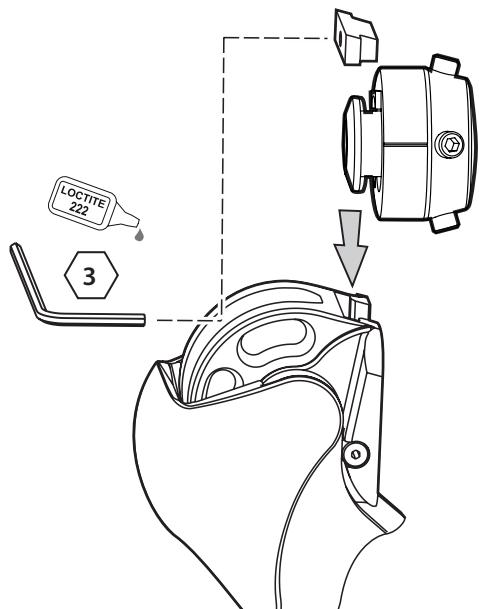

Telaio ESK+ a 4 viti



938205

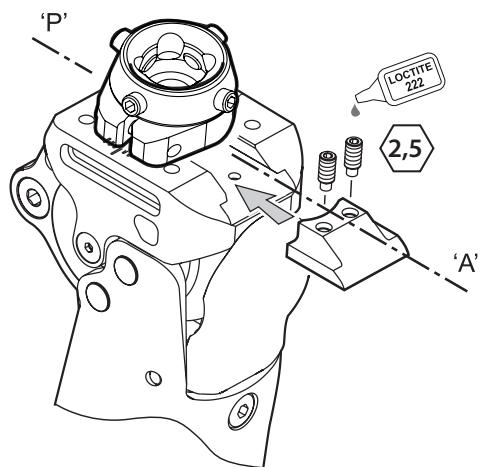


Linx, Orion3




938353



938374

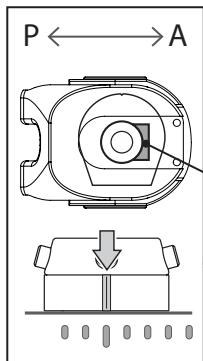


Dispositivo
anti-rotazione –
anteriore

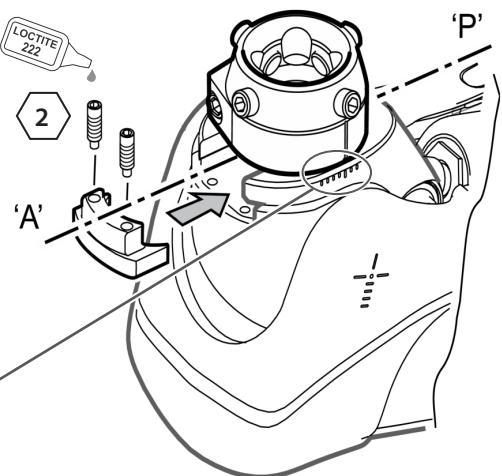


KX06V2



938409



Dispositivo
anti-rotazione –
anteriore

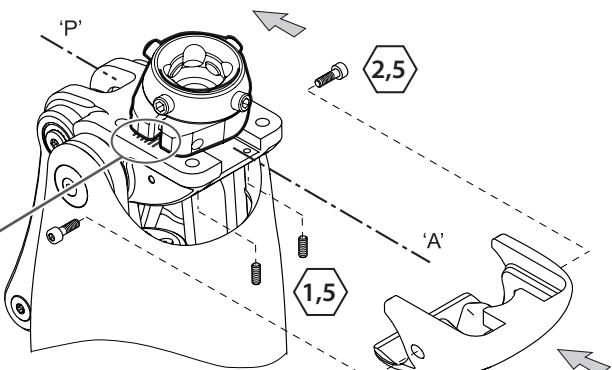


8 Dati tecnici

Intervallo di temperatura di esercizio e stoccaggio:	da -15 °C a 50 °C
Peso del componente:	114 g
Livello di attività:	1–4
Peso massimo del paziente:	166 kg
Ingombro verticale:	28 mm
Tipo di attacco:	Distale — Telaio con scanalatura o alloggiamento superiore Prossimale — Piramide femmina (Blatchford)
Intervallo di regolazione:	Rotazione 360° ±7° di inclinazione da verticale
Traslazione A-P:	15 mm (pilone dinamico) 15 mm (ginocchio Mercury) 6 mm (telaio ESK+ a 4 viti) 8 mm (Linx, Orion3) 15 mm (KX06V2)

Ingombro verticale

L'altezza del dispositivo è fissa.

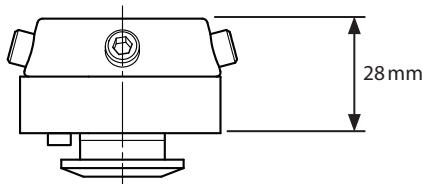

Immagazzinamento

Se inutilizzato per periodi lunghi, accertarsi che il prodotto non presenti segni di umidità e sia conservato a temperatura ambiente.

9 Informazioni sulle ordinazioni

Dispositivo	Codice articolo
Raccordo traslatore con piramide femmina	189128

Responsabilità

Il produttore raccomanda l'utilizzo del dispositivo esclusivamente nelle condizioni specificate e per gli impieghi previsti. Il dispositivo deve essere sottoposto a manutenzione conformemente alle istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo. Il produttore non è responsabile dei danni causati dalle combinazioni dei componenti non autorizzati dal produttore.

Conformità CE

Questo prodotto soddisfa i requisiti del Regolamento europeo UE 2017/745 relativo ai dispositivi medici. Il presente prodotto è stato classificato come dispositivo di classe I in base ai criteri di classificazione delineati nell'Allegato VIII del regolamento. Il certificato di dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo di posta elettronica: www.blatchford.co.uk



Dispositivo medico



Monopaziente – Utilizzo multiplo

Compatibilità

La combinazione con i prodotti a marchio Blatchford è approvata in base a test condotti in conformità alle norme pertinenti e all'MDR, compresi test strutturali, compatibilità dimensionale e prestazioni sul campo monitorate.

La combinazione con prodotti alternativi a marchio CE deve essere eseguita in considerazione di una valutazione del rischio locale documentata svolta da un tecnico ortopedico.

Garanzia

Il dispositivo è garantito per 24 mesi.

Il paziente deve essere informato che eventuali variazioni o modifiche non espressamente approvate possono comportare l'annullamento della garanzia e il decadimento delle licenze operative e delle esenzioni.

Consultare sul sito web Blatchford la dichiarazione di garanzia completa vigente.

Segnalazione di incidenti gravi

Nell'improbabile caso di incidente grave che si verifica in relazione a questo dispositivo, si raccomanda di inviare una segnalazione al produttore e all'autorità nazionale competente.

Indicazioni ambientali

Questo prodotto è stato realizzato utilizzando materiali riciclabili. Ove possibile, i componenti devono essere riciclati in conformità con le normative in materia di gestione dei rifiuti vigenti a livello locale.

Conservare l'etichetta dell'imballaggio

Si consiglia al tecnico ortopedico di conservare l'etichetta dell'imballaggio come documentazione del dispositivo fornito.

Riconoscimento dei marchi commerciali

Blatchford è un marchio registrato di Blatchford Products Limited.

Sede legale del produttore

Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, Regno Unito.

Contenido	42
1 Descripción y uso previsto	43
2 Información de seguridad.....	44
3 Estructura	45
4 Función	46
5 Mantenimiento	46
6 Limitaciones de uso.....	47
7 Montaje y alineación.....	47
8 Datos técnicos	50
9 Información para pedidos.....	50

1 Descripción y uso previsto

Estas instrucciones de uso están destinadas para ser utilizadas por el profesional sanitario y el usuario, a menos que se indique lo contrario.

El término *dispositivo* se utiliza en este documento para referirse al adaptador de pirámide hembra con desplazamiento.

Siga leyendo para asegurarse de que entiende estas instrucciones y, especialmente, toda la información de seguridad y las instrucciones de mantenimiento.

Aplicación

Este dispositivo debe utilizarse únicamente con prótesis modulares de extremidad inferior para un solo usuario.

El dispositivo está diseñado para conectar un chasis con ranura de extremo abierto o una carcasa superior de Blatchford a un receptáculo para pirámide macho. De esta forma se puede ajustar el desplazamiento, el ángulo y la rotación entre las dos partes de la extremidad.

Funciones

- Estructura liviana y resistente de titanio y aluminio

Nivel de actividad

Este dispositivo resulta adecuado para unos niveles de actividad de entre 1 y 4 (existen límites de peso; consultar *Datos técnicos*). Por supuesto, hay excepciones y en nuestra recomendación queremos dar cabida a circunstancias individuales y únicas, y toda decisión al respecto debe tomarse con la debida y rigurosa consideración.

Nivel de actividad 1

Tiene la capacidad o el potencial de utilizar una prótesis para la transferencia o la ambulación sobre superficies regulares con cadencia de marcha fija. Esto es típico de los usuarios ambulatorios con capacidad limitada o ilimitada de caminar dentro de su casa.

Nivel de actividad 2

Tiene la capacidad o el potencial de ambulación y puede salvar barreras del entorno de bajo nivel, como bordillos, escaleras o superficies irregulares. Esto es típico de los usuarios ambulatorios con capacidad limitada para caminar en su entorno exterior.

Nivel de actividad 3

Tiene la capacidad o el potencial de ambulación con cadencia de marcha variable. Típico del usuario ambulatorio con capacidad para caminar por su entorno exterior y salvar la mayoría de barreras del entorno, con un interés por realizar actividades vocacionales, terapéuticas o de ejercicio que exijan utilizar la prótesis para más que la simple locomoción.

Nivel de actividad 4

Tiene una capacidad o potencial de ambulación con prótesis que excede las habilidades de ambulación básica, con altos niveles de impacto, tensión o energía. Típico de las exigencias de una prótesis para niños, adultos activos o atletas.

Contraindicaciones

No se conoce ninguna contraindicación si se utiliza siguiendo estas instrucciones.

Beneficio clínico

Proporciona una conexión entre distintos componentes protésicos que hace posible un cierto grado de ajuste de la alineación.

2 Información de seguridad



Este símbolo de advertencia subraya la información importante de seguridad que se debe observar.



Cualquier cambio en el rendimiento o el funcionamiento de la extremidad (por ejemplo, juego excesivo o ruidos inusuales) debe notificarse inmediatamente al proveedor de servicios.



Agarrarse siempre a la barandilla al bajar las escaleras y en cualquier otro momento si la hubiera.



El dispositivo se puede utilizar como prótesis para la ducha, pero no está diseñado para su inmersión prolongada bajo el agua. Secar inmediatamente tras el contacto con el agua. Si este dispositivo entra en contacto con agua salina o clorada, debe enjuagarse con agua corriente y secarse. Cualquier uso del dispositivo en el agua deberá cumplir con las condiciones que se indican en *Limitaciones de uso*.



El montaje, mantenimiento y reparación del dispositivo solo debe llevarlos a cabo un profesional sanitario con la debida titulación.



El usuario no debe ajustar ni alterar la configuración del dispositivo.



Se recomienda al usuario que se ponga en contacto con su profesional sanitario si cambia su cuadro clínico.



Para reducir el riesgo de lesiones o de que se aflojen las conexiones de los tornillos, asegúrese de que las roscas de los pernos estén totalmente limpias antes de cada instalación.




Aplicar siempre el valor de par de apriete especificado a los tornillos.

3 Estructura

Componentes principales

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| • Pirámide hembra | Titanio |
| • Collarín/Anillo de cierre | Aleación de aluminio |
| • Tornillos de fijación de pirámide | Acero chapado (4 uds.) |
| • Tornillo de retención e insertos | Acero chapado |

Identificación de componentes

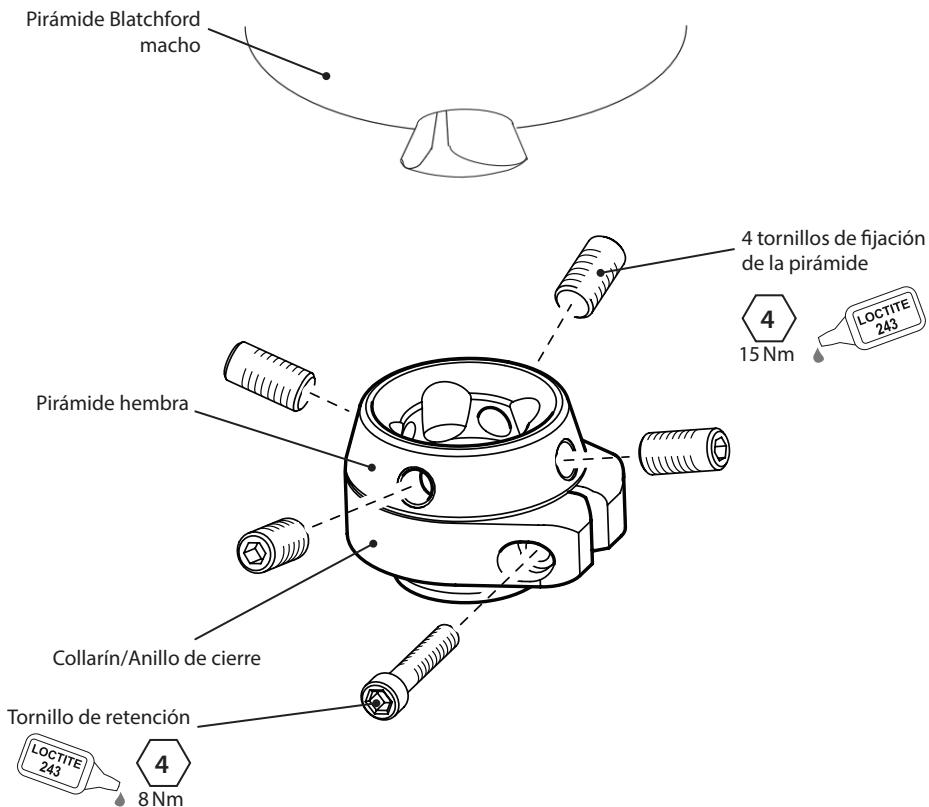

4 Función

Este dispositivo consta de dos componentes principales. El movimiento entre estos dos componentes antes de apretar los tornillos de la pirámide y el tornillo de retención permite adaptar la alineación a las necesidades individuales del usuario. Cuando se aprieta firmemente hasta el par indicado y se sella con Loctite 243, este dispositivo ofrece un modo seguro de conectar las dos partes de la extremidad.

5 Mantenimiento

Realizar una inspección visual periódica del dispositivo.

Notificar al profesional sanitario o proveedor del servicio cualquier cambio en el rendimiento de este dispositivo, p. ej., ruidos inusuales, movimiento, o desgaste considerable.

También se debe informar al profesional sanitario/proveedor del servicio de cualquier cambio en el peso corporal o nivel de actividad.

Limpieza

Limpiar las superficies externas con un paño húmedo y jabón suave. NO utilizar limpiadores agresivos.

El resto de las instrucciones de esta sección están destinadas exclusivamente al profesional sanitario.

El mantenimiento debe llevarlo a cabo únicamente el personal competente (profesional sanitario o técnico con la debida formación).

El siguiente mantenimiento rutinario debe llevarse a cabo al menos una vez al año:

- Comprobar que estén bien apretados los tornillos de sujeción y los tornillos de bloqueo. Si están sueltos, retirarlos y limpiarlos y, seguidamente, aplicar Loctite 243 y apretar con el par adecuado; consultar la sección *Estructura*.
- Comprobar si existe algún defecto que pueda afectar al correcto funcionamiento.

Cerciorarse de que el usuario haya leído y comprendido toda la información de seguridad y de mantenimiento dirigida específicamente al usuario.

Recomendar al usuario que efectúe periódicamente una inspección visual del dispositivo e informe al proveedor del servicio de cualquier señal de desgaste que pudiera afectar al funcionamiento (p. ej. desgaste considerable o corrosión).

Aconsejar al usuario que informe al profesional sanitario/proveedor del servicio de cualquier cambio en el peso corporal o nivel de actividad.

Si este dispositivo se utiliza para actividades extremas, se deberán revisar el nivel y los intervalos de mantenimiento y, en caso necesario, obtener asesoramiento y asistencia técnica para diseñar un nuevo programa de mantenimiento con arreglo a la frecuencia y la naturaleza de la actividad. Esto debe determinarse mediante una evaluación de riesgos local realizada por un profesional debidamente cualificado.

6 Limitaciones de uso

Vida útil prevista

Se debe llevar a cabo una evaluación de riesgos local según el tipo de actividad y el uso.

Levantamiento de cargas

El peso y la actividad del usuario están gobernados por los límites indicados.

El transporte de cargas por el usuario debe basarse en una evaluación de riesgos local.

Entorno

Este dispositivo se puede utilizar como prótesis para la ducha, pero no está diseñado para su inmersión prolongada bajo el agua. Si este dispositivo entra en contacto con agua salina o clorada, debe enjuagarse con agua corriente y secarse. Una corrosión ligera en la superficie no afecta al funcionamiento ni a la seguridad de este dispositivo. Sin embargo, si está muy oxidado, debe dejar de usarlo y ponerse en contacto con su profesional sanitario.

Utilizar exclusivamente con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 50 °C.



Adecuado para su uso en la ducha

7 Montaje y alineación


Las instrucciones de esta sección están dirigidas exclusivamente al profesional sanitario.

Ajustar la alineación de los componentes para optimizar el funcionamiento y el confort.
Colocar lo más cerca posible de la línea de construcción.

Pilón dinámico




938306

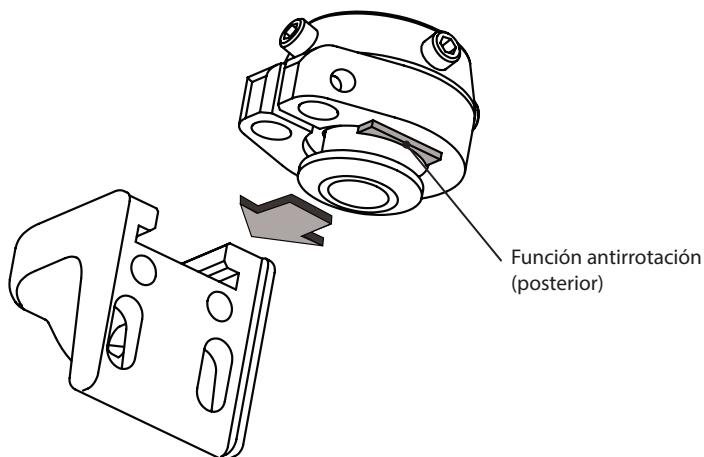


Rodilla Mercury




938251




Función
antirrotación
(anterior)

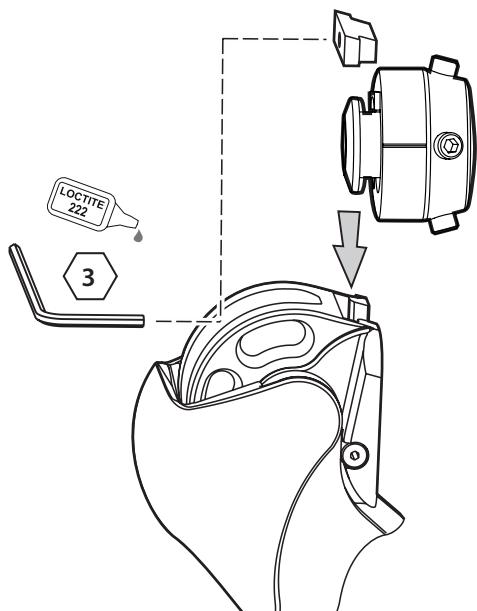


Chasis ESK+ de 4 tornillos



938205



Función
antirrotación
(anterior)

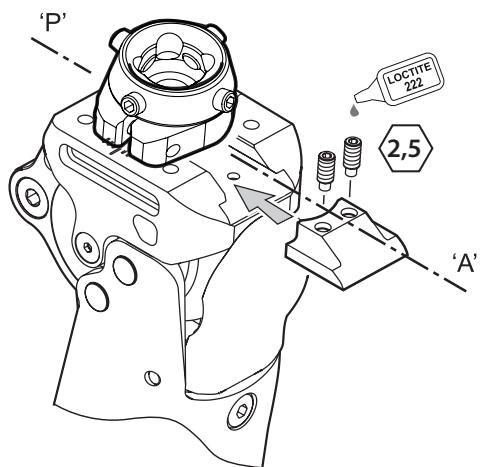


Linx, Orion3




938353



938374

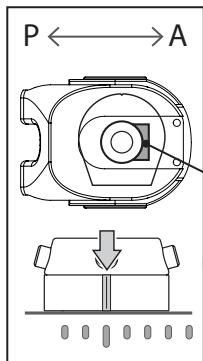


Función
antirrotación
(anterior)

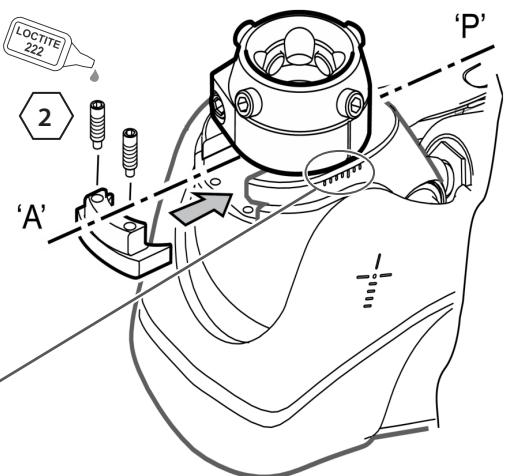


KX06V2



938409



Función
antirrotación
(anterior)

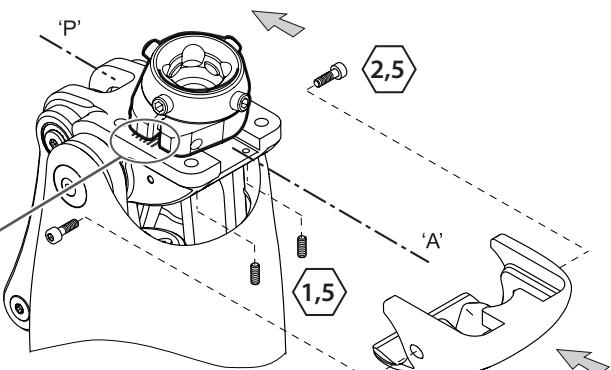


8 Datos técnicos

Rango de temperaturas de funcionamiento y almacenaje:	-15 °C a 50 °C
Peso del componente:	114 g
Nivel de actividad:	1-4
Peso máximo del usuario:	166 kg
Altura de la prótesis:	28 mm
Tipo de ajuste:	Distal: Chasis con ranura o carcasa superior Proximal: pirámide hembra (Blatchford)
Rango de ajuste:	360 ° de rotación ±7° de inclinación con respecto al plano vertical
Desplazamiento anteroposterior:	15 mm (pilón dinámico) 15 mm (rodilla Mercury) 6 mm (chasis ESK+ de 4 tornillos) 8 mm (Linx, Orion3) 15 mm (KX06V2)

Altura de la prótesis

La altura del dispositivo es fija.

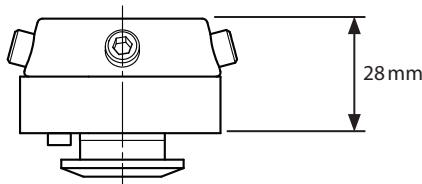

Almacenaje y manipulación

Si se va a guardar durante períodos largos, asegurarse de que el producto se guarde a temperatura ambiente y no quede expuesto a humedad.

9 Información para pedidos

Dispositivo	Referencia
Adaptador de pirámide hembra con desplazamiento	189128

Responsabilidad

El fabricante recomienda utilizar el dispositivo únicamente en las condiciones especificadas y para el fin previsto. El mantenimiento del dispositivo debe llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones de uso suministradas con él. El fabricante no se hace responsable de ningún resultado adverso que pueda surgir de una combinación de componentes que no haya autorizado previamente.

Declaración de conformidad de la CE

Este producto cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios. Este producto está clasificado como dispositivo de Clase I según las normas de clasificación estipuladas en el Anexo VIII del reglamento. El certificado y la declaración de conformidad de la UE pueden consultarse en la siguiente dirección de Internet:
www.blatchford.co.uk



Dispositivo médico



Para uso en un solo paciente -
uso múltiple

Compatibilidad

Está autorizada la combinación con productos de la marca Blatchford basándose en pruebas según las normas correspondientes y el MDR, incluidas pruebas estructurales, de compatibilidad dimensional y de rendimiento supervisado sobre el terreno.

La combinación con productos alternativos con marcado CE debe llevarse a cabo de acuerdo con una evaluación de riesgos local documentada por un profesional sanitario.

Garantía

El dispositivo tiene 24 meses de garantía.

El usuario debe tener en cuenta que todo cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado podría invalidar la garantía, las autorizaciones de explotación y cualquier tipo de exenciones.

Consultar la declaración de garantía completa vigente en la página web de Blatchford.

Notificación de incidentes graves

En el caso poco probable de que se produzca un incidente grave relacionado con este dispositivo, se deberá notificar al fabricante y a la autoridad competente nacional.

Aspectos medioambientales

Este producto está fabricado con material reciclable. Siempre que sea posible, los componentes se deben reciclar de acuerdo con el reglamento local de gestión de residuos.

Conservar la etiqueta del embalaje

Aconsejamos al profesional sanitario conservar la etiqueta del embalaje como recordatorio del dispositivo suministrado.

Marcas comerciales

Blatchford es una marca registrada de Blatchford Products Limited.

Dirección registrada del fabricante

Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke, RG22 4AH (REINO UNIDO).

Inhoud.....	52
1 Beschrijving en beoogd gebruik	53
2 Veiligheidsinformatie.....	54
3 Constructie	55
4 Functie.....	56
5 Onderhoud.....	56
6 Beperkingen bij het gebruik	57
7 Montage en uitlijning	57
8 Technische gegevens.....	60
9 Bestelinformatie	60

1 Beschrijving en beoogd gebruik

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de behandelaar en de gebruiker, tenzij anders aangegeven.

De term *hulpmiddel* verwijst in dit document naar de vrouwelijke piramideadapter met verschuiving.

Lees deze instructies door en waarborg dat u alles begrijpt; in het bijzonder de veiligheidsinformatie en de instructies voor onderhoud.

Toepassing

Dit hulpmiddel mag uitsluitend worden gebruikt voor modulaire prothesen van de onderste ledematen en is bedoeld voor gebruik bij één persoon.

Het hulpmiddel is bedoeld voor het aansluiten van een chassis van Blatchford met gleuven en een open uiteinde, of bovenbehuizing met open uiteinde, op een ontvangende mannelijke piramide. Dit maakt aanpassingen in de vorm van verschuiven, kantelen en rotatie tussen de twee onderdelen van de ledemaat mogelijk.

Kenmerken

- Lichtgewicht, sterke constructie van titanium en aluminium

Activiteitenniveau

Dit hulpmiddel is geschikt voor activiteiten niveaus 1 t/m 4 (er zijn gewichtslimieten van toepassing, raadpleeg *Technische gegevens*). Natuurlijk zijn er uitzonderingen. In onze aanbeveling willen we rekening houden met unieke, individuele omstandigheden en daarom hoort elke beslissing op dit vlak te worden genomen op basis van een duidelijke en grondige onderbouwing.

Activiteiten niveau 1

Heeft het vermogen of de potentie om een prothese te gebruiken voor verplaatsingen of lopen over een vlakke ondergrond met een vaste cadans. Typisch voor mensen die in huis korte en langere afstanden kunnen overbruggen.

Activiteiten niveau 2

Heeft het vermogen of de potentie om te lopen over een ondergrond met lage obstakels, zoals stoepranden, trappen of ongelijke oppervlakken. Typisch voor mensen die in de omgeving korte afstanden kunnen overbruggen.

Activiteiten niveau 3

Heeft het vermogen of de potentie om te lopen met variabele cadans. Typisch voor mensen die in de omgeving langere afstanden kunnen overbruggen inclusief de meeste obstakels die in de omgeving aanwezig zijn en die te maken hebben met beroepsmatige, therapeutische of inspanningsactiviteiten waarbij er meer eisen aan het gebruik van de prothese worden gesteld dan bij gewoon lopen.

Activiteiten niveau 4

Heeft het vermogen of de potentie om meer activiteiten met een prothese te ondernemen dan alleen lopen; dit betreft activiteiten met een hoog impact-, spannings- of energieniveau. Typisch voor eisen die kinderen, actieve volwassenen of atleten aan een prothese stellen.

Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend wanneer het hulpmiddel wordt gebruikt in overeenstemming met deze instructies.

Klinisch voordeel

Zorgt voor het aansluiten van prothesecomponenten waardoor enige aanpassing in uitlijning kan worden verkregen.

2 Veiligheidsinformatie



Dit waarschuwingssymbool benadrukt belangrijke veiligheidsinformatie die zorgvuldig moet worden opgevolgd.



Elke verandering in de prestaties of werking van de ledemaatprothese, zoals overmatige speling of ongebruikelijke geluiden, moet onmiddellijk worden gemeld aan de leverancier.



Gebruik bij het aflopen van een trap altijd de leuning en indien mogelijk ook bij andere activiteiten.



Het hulpmiddel kan als doucheprothese worden gebruikt, maar is niet bedoeld voor langdurige onderdompeling in water. Na contact met water direct droogvegen. Als het hulpmiddel met zout of gechloreerd water in aanraking komt, moet het met zoet water worden afgespoeld en worden gedroogd. Controleer of gebruik van het hulpmiddel in water voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld onder *Beperkingen bij het gebruik*.



Montage, onderhoud en reparatie van het hulpmiddel mogen alleen worden uitgevoerd door een hiervoor gekwalificeerde behandelaar.



De gebruiker mag de instelling van het hulpmiddel niet eigenhandig instellen of wijzigen.



De gebruiker wordt geadviseerd om contact op te nemen met de behandelaar als zijn/haar toestand verandert.



Om het risico op letsel door het falen of loskomen van de boutverbindingen te verminderen, moet worden gewaarborgd dat de schroefdraad van de bouten vóór elke plaatsing grondig wordt gereinigd.




Pas altijd het aangegeven aandraaimoment toe op de schroeven.

3 Constructie

Belangrijkste onderdelen

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| • Vrouwelijke piramide | Titanium |
| • Kraag-/klemring | Aluminiumlegering |
| • Schroeven piramideset | Geplateerd staal (4 stuks) |
| • Klemschroef en inzetschroeven | Geplateerd staal |

Identificatie componenten

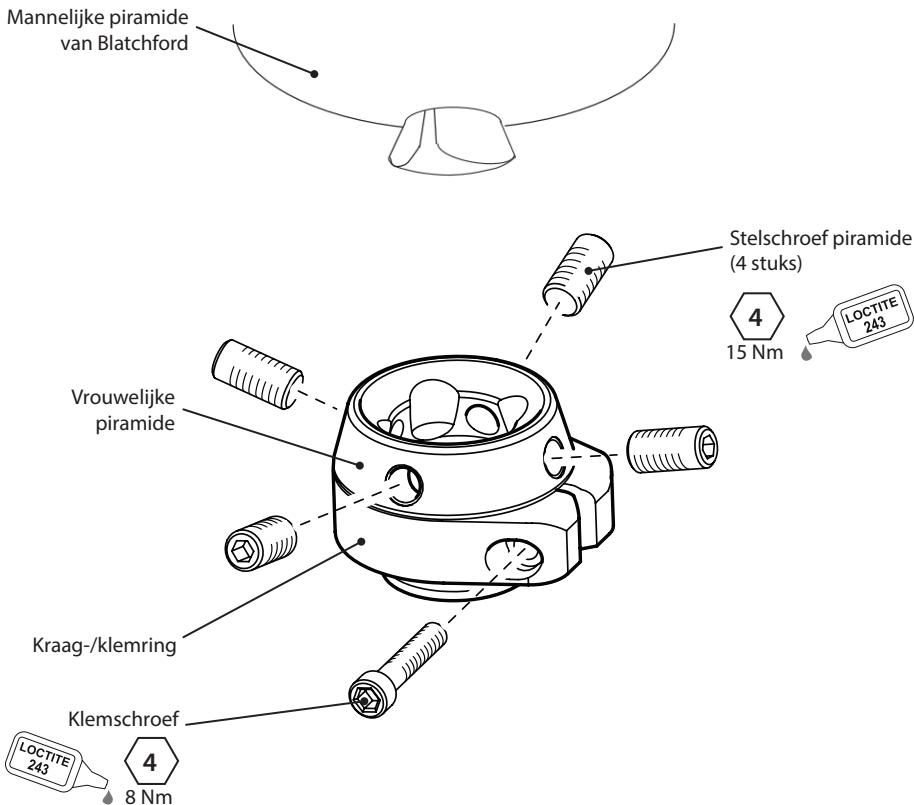

4 Functie

Dit hulpmiddel bestaat uit twee hoofdonderdelen. De beweging tussen deze twee onderdelen voor het aandraaien van de piramideschroeven en klemschroef zorgt ervoor dat de ledemaat kan worden uitgelijnd, afhankelijk van de behoefte van de betreffende gebruiker. Na het goed aandraaien met behulp van Loctite 243 tot het aangegeven aandraaimoment, biedt dit hulpmiddel een veilige manier om twee onderdelen van de ledemaatprothese met elkaar te verbinden.

5 Onderhoud

Voer regelmatig een visuele controle van het hulpmiddel uit.

Meld elke verandering in prestaties van dit hulpmiddel, zoals ongebruikelijke geluiden, beweging of aanzienlijke slijtage, aan de behandelaar/leverancier.

Informeer de behandelaar/leverancier over elke verandering in lichaamsgewicht en/of activiteiten niveau.

Reiniging

Gebruik een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel om de buitenoppervlakken te reinigen. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

De resterende instructies in dit hoofdstuk zijn alleen bedoeld voor gebruik door de behandelaar.

Dit onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door competent personeel (behandelaar of een hiervoor opgeleide technicus).

Het volgende routinematige onderhoud dient ten minste eenmaal per jaar te worden uitgevoerd:

- Controleer of de bevestigingsschroeven en borgschroeven stevig vast zitten. Als deze los zitten, moeten ze worden verwijderd en gereinigd. Breng daarna Loctite 243 aan en draai ze weer aan tot het juiste aandraaimoment; raadpleeg het hoofdstuk *Constructie*.
- Controleer op defecten die van invloed kunnen zijn op een juiste werking.

Controleer of de gebruiker alle informatie betreffende veiligheid en door de gebruiker uit te voeren onderhoud heeft gelezen en begrepen.

Adviseer de gebruiker om het hulpmiddel regelmatig visueel te controleren; tekenen van slijtage die de werking kunnen aantasten (bv. aanzienlijke schade of corrosie) moeten aan de leverancier worden gemeld.

Adviseer de gebruiker om de behandelaar/leverancier op de hoogte te brengen van elke verandering in lichaamsgewicht en/of activiteiten niveau

Als het hulpmiddel wordt gebruikt voor extreme activiteiten, moeten het onderhoudsniveau en -interval worden herzien en moet zo nodig technische ondersteuning worden gevraagd voor het opstellen van een nieuw onderhoudsschema afhankelijk van de aard en de frequentie van de activiteiten. Dit moet worden bepaald door een risicobeoordeling ter plaatse die door een daarvoor gekwalificeerde persoon wordt uitgevoerd.

6 Beperkingen bij het gebruik

Beoogde levensduur

Er moet ter plaatse een risicobeoordeling worden uitgevoerd op basis van de activiteiten en het gebruik.

Zwaar tillen

Het gewicht van de gebruiker en de belasting worden bepaald door de aangegeven limieten.

Het tillen en dragen van zware lasten door de gebruiker moet zijn gebaseerd op een risicobeoordeling ter plaatse.

Omgeving

Dit hulpmiddel kan als doucheprothese worden gebruikt, maar is niet bedoeld voor langdurige onderdompeling in water. Als het hulpmiddel met zout of gechloreerd water in aanraking komt, moet het met zoet water worden afgespoeld en worden gedroogd. Lichte corrosie op het oppervlak heeft geen nadelige gevolgen voor het functioneren of de veiligheid van dit hulpmiddel. Als echter zware corrosie aanwezig is, moet u het gebruik van dit hulpmiddel staken en contact met uw behandelaar opnemen.

Uitsluitend voor gebruik bij temperaturen tussen -15 °C en 50 °C.




Geschikt voor gebruik onder de douche

7 Montage en uitlijning


De instructies in dit hoofdstuk zijn alleen bedoeld voor gebruik door de behandelaar.

Pas de uitlijning van de componenten aan voor een optimale werking en optimaal comfort. Positioneer het hulpmiddel zo dicht als praktisch mogelijk bij de middellijn van de constructie.


Dynamische pyloon





938306

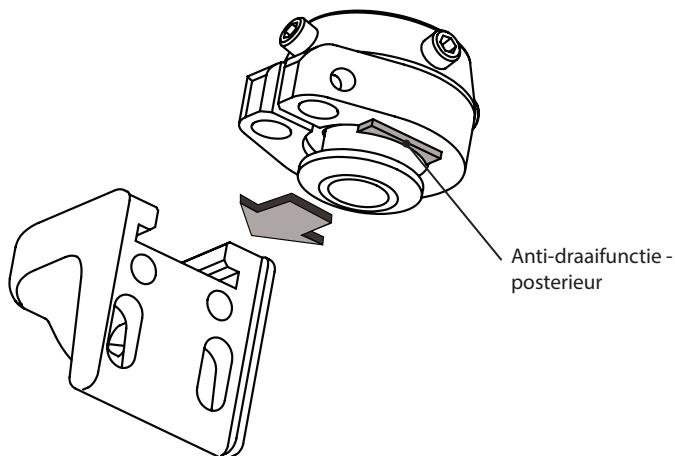

Mercury-knie





938251

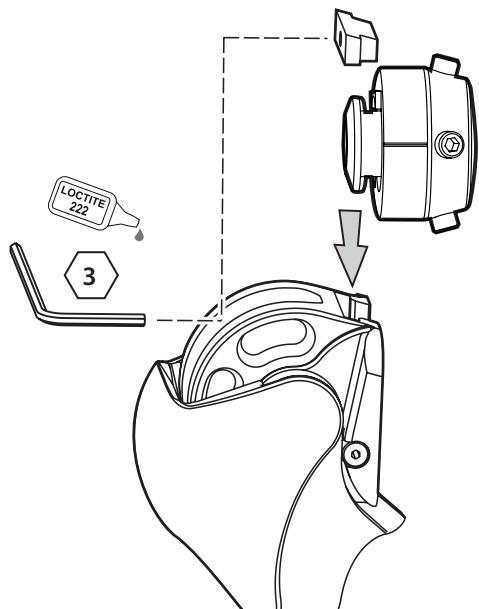

ESK+ 4-bouts chassis



938205

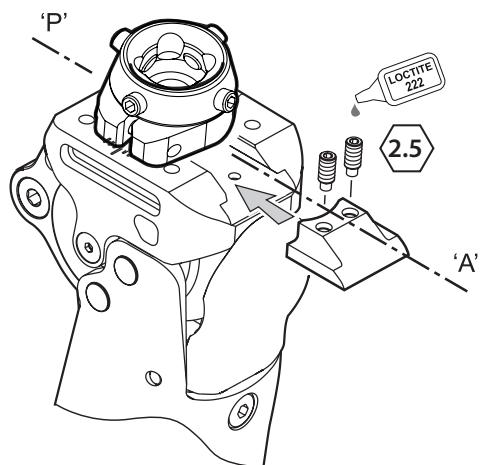



Linx, Orion3



938353





938374

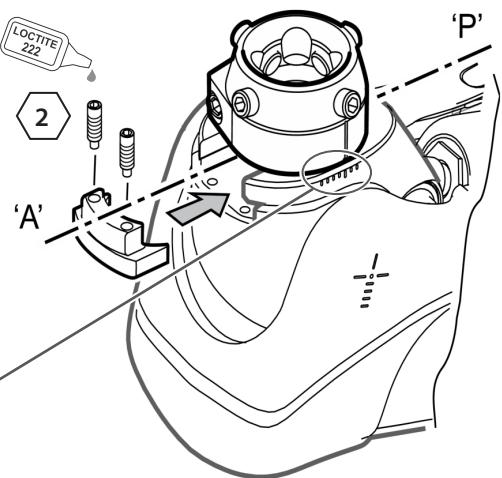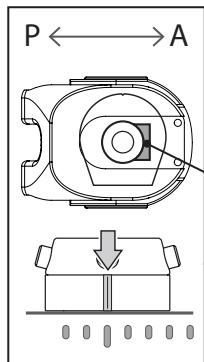

KX06V2



938409

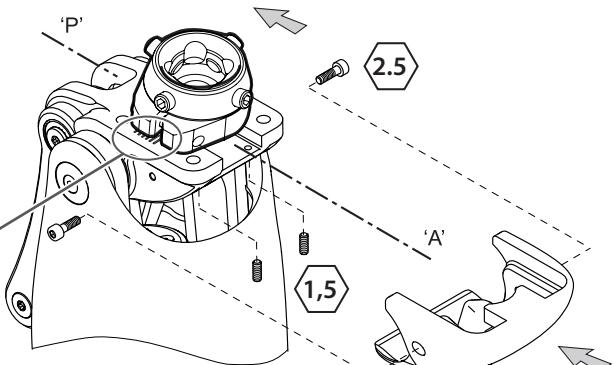


8 Technische gegevens

Temperatuurbereik voor gebruik en opslag:	-15 °C tot 50 °C
Gewicht component:	114 g
Activiteitenniveau:	1 - 4
Maximaal gewicht gebruiker:	166 kg
Constructiehoogte:	28 mm
Type bevestiging:	Distaal: chassis met gleuven of bovenbehuizing Proximaal: vrouwelijke piramide (Blatchford)
Instelbereik:	360° rotatie ±7° kanteling t.o.v. verticaal
A-P-verschuiving:	15 mm (dynamische pyloon) 15 mm (Mercury-knie) 6 mm (ESK+ 4-bouts chassis) 8 mm (Linx, Orion3) 15 mm (KX06V2)

Constructiehoogte

De hoogte van het hulpmiddel is vast.

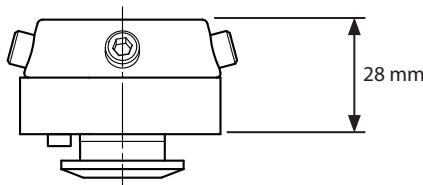

Opslag en hantering

Zorg er bij langdurige opslag voor dat het product vrij is van vocht en bij kamertemperatuur wordt opgeslagen.

9 Bestelinformatie

Hulpmiddel	Onderdeelnr.
Vrouwelijke piramideadapter met verschuiving	189128

Aansprakelijkheid

De fabrikant raadt aan het hulpmiddel alleen onder de gespecificeerde omstandigheden en voor de beoogde doeleinden te gebruiken. Het hulpmiddel moet worden onderhouden volgens de bij het hulpmiddel geleverde gebruiksaanwijzing. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enig negatief resultaat dat wordt veroorzaakt door combinaties van componenten die niet door de fabrikant zijn geautoriseerd.

CE-conformiteit

Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Verordening EU 2017/745 voor medische hulpmiddelen. Dit product is geclasseerd als product van klasse I volgens de classificatiecriteria zoals uiteengezet in bijlage IX van de verordening. Het certificaat van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.blatchford.co.uk



Medisch hulpmiddel



Eén patiënt - meervoudig gebruik

Compatibiliteit

Het combineren met producten van het merk Blatchford is goedgekeurd op basis van testen in overeenstemming met relevante normen en de MDR, waaronder structurele testen, compatibiliteit in afmetingen en gemonitorde prestaties in het veld.

Het combineren met alternatieve producten met een CE-markering moet worden uitgevoerd op basis van een gedocumenteerde risicobeoordeling ter plaatse die door een behandelaar is uitgevoerd.

Garantie

Dit hulpmiddel heeft een garantie van 24 maanden.

De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat bij wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd, de garantie, gebruikslicenties en uitzonderingen kunnen komen te vervallen.

Raadpleeg de website van Blatchford voor de actuele volledige garantieverklaring.

Ernstige incidenten melden

In het onwaarschijnlijke geval van een ernstig incident dat zich voordoet met betrekking tot dit hulpmiddel, moet dit worden gemeld bij de fabrikant en de bevoegde instantie van uw land.

Milieuaspecten

Dit product is vervaardigd uit recycleerbaar materiaal. Waar mogelijk moeten de componenten worden gerecycled in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving op het gebied van afvalverwerking.

Het etiket van de verpakking bewaren

De behandelaar wordt geadviseerd het etiket van de verpakking te bewaren als registratie van het geleverde hulpmiddel.

Erkenning handelsmerken

Blatchford is een geregistreerd handelsmerk van Blatchford Products Limited.

Geregistreerd adres fabrikant

Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, VK.

Spis treści



Spis treści	62
1 Opis i przeznaczenie	63
2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa	64
3 Budowa	65
4 Zasada działania	66
5 Konserwacja	66
6 Ograniczenia w użytkowaniu	67
7 Montaż i osiowanie	67
8 Specyfikacja techniczna	70
9 Składanie zamówień	70

1 Opis i przeznaczenie

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla lekarza i użytkownika, chyba że określono inaczej.

Termin *wyrób* używany w niniejszym dokumencie odnosi się adaptera z przesuwnym złączem piramidalnym żeńskim.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu i upewnienie się, że wszystkie instrukcje użytkowania są zrozumiałe, a w szczególności wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje konserwacji.

Zastosowanie

Ten wyrób przeznaczony jest do użytku wyłącznie jako element modułowy protezy koźczyny dolnej u jednego użytkownika.

Niniejszy wyrób przeznaczony jest do łączenia górnej obudowy lub otwartej obudowy szczelinowej Blatchford z adapterem ze złączem piramidalnym męskim. Pozwala to na regulację przesuwną, kątową i obrotową między dwoma komponentami protezy koźczyny.

Cechy charakterystyczne

- Lekka, wytrzymała konstrukcja z tytanu i aluminium

Poziom aktywności

Ten wyrób jest odpowiedni dla użytkowników na poziomie aktywności 1–4 (obowiązują ograniczenia wagowe, patrz *Specyfikacja techniczna*). Oczywiście istnieją od tego wyjątki i w naszych zaleceniach pragniemy uwzględnić nietypowe, indywidualne okoliczności. Każdą taką decyzję należy jednak podjąć po wnikliwej i szczegółowej ocenie danego przypadku.

Poziom aktywności 1

Zdolność lub potencjalna możliwość poruszania się i przenoszenia koźczyny na równych powierzchniach przy stałej kadencji. Typowy model poruszania się z ograniczeniami lub bez, w warunkach domowych.

Poziom aktywności 2

Zdolność lub potencjalna możliwość poruszania się z pokonywaniem niskich przeszkoł, takich jak krawężniki, schody lub nierówne powierzchnie. Typowy model poruszania się w ograniczonym zakresie poza domem.

Poziom aktywności 3

Zdolność lub potencjalna możliwość poruszania się ze zmieniąką kadencją. Zalecana osobom funkcjonującym w społeczeństwie, które oprócz wykorzystywania protezy do przemieszczania się, są zdolne do pokonywania większości barier środowiskowych i są w stanie podejmować czynności zawodowe, terapeutyczne lub ruchowe.

Poziom aktywności 4

Zdolność lub potencjalna możliwość chodzenia z protezą wykraczającą poza podstawowe możliwości przemieszczania się, co obejmuje poruszanie się ze znacznym obciążaniem i naciskiem koźczyn oraz formy aktywności wymagające dużego nakładu energii. Spełnia wymagania protetyczne typowe dla dziecka, aktywnej osoby dorosłej lub sportowca.

Przeciwwskazania

Brak znanych przeciwwskazań, jeśli wyrób jest użytkowany zgodnie z niniejszą instrukcją.

Korzyści kliniczne

Zapewnia połączenie między elementami protetycznymi, co pozwala na regulację podczas osiowania.

2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Ten symbol ostrzegawczy oznacza istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Wszelkie zmiany w działaniu lub funkcjonowaniu protezy, np. nadmierny luz lub nietypowe odgłosy, należy natychmiast zgłaszać świadczeniodawcy.



Przy schodzeniu, zwłaszcza po schodach, zawsze należy korzystać z poręczy, o ile jest dostępna.



Ten wybór może być używany jako proteza stosowana pod prysznicem, ale nie jest on przeznaczony do długotrwałego zanurzenia w wodzie. Po kontakcie z wodą natychmiast wytrzeć do sucha. W przypadku kontaktu tego wyrobu ze słoną lub chlorowaną wodą należy go przepłukać wodą słodką i wysuszyć. Każde użycie wyrobu w wodzie musi spełniać warunki użytkowania opisane w punkcie *Ograniczenia w użytkowaniu*.



Montaż, konserwację i naprawę niniejszego wyrobu mogą przeprowadzać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowani specjaliści.



Użytkownikom nie wolno samodzielnie zmieniać ustawień wyrobu.



Użytkownika należy poinformować, że jeśli jego stan zdrowia ulegnie zmianie, powinien on skontaktować się ze swoim lekarzem.



Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała spowodowanych uszkodzeniem lub poluzowaniem połączeń śrubowych, przed każdym założeniem należy dokładnie oczyścić gwinty śrub.




Śruby należy przykręcać wskazanym momentem dokręcania.

3 Budowa

Główne elementy

- | | |
|---|-----------------------|
| • Złącze piramidalne żeńskie | Tytan |
| • Kołnierz/ pierścień zaciskowy | Stop aluminium |
| • Śruby ustalające złącza piramidalnego | Stal platerowana (x4) |
| • Śruba zaciskowa i wkładki | Stal platerowana |

Elementy składowe

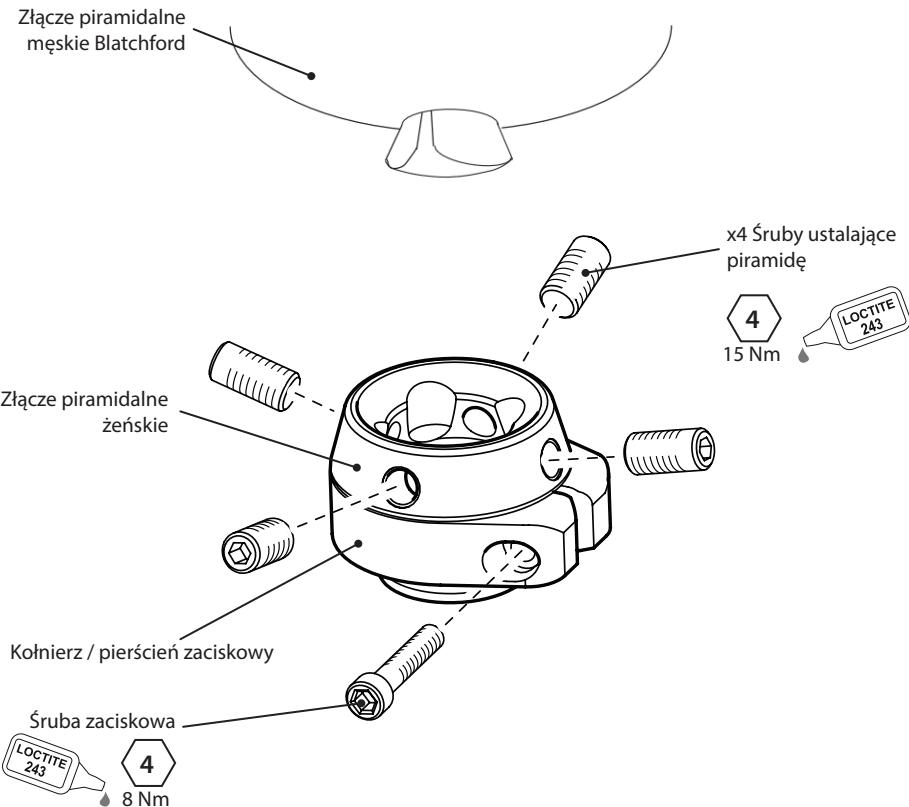

4 Zasada działania

Niniejszy wyrób składa się z dwóch głównych komponentów. Ruch pomiędzy tymi dwoma komponentami przed dokręceniem śrub złącza piramidalnego i śruby zaciskowej pozwala na regulację wyosiania kończyny zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika. Po prawidłowym dokręceniu przedstawionym momentem dokręcania i zastosowaniu kleju Loctite 243 wyrób pozwala na bezpieczne połączenie dwóch elementów protezy kończyny.

5 Konserwacja

Wyrób należy regularnie sprawdzać wzrokowo.

Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu niniejszego wyrobu, np. nietypowe odgłosy, luzy lub znaczne zużycie elementów należy zgłaszać lekarzowi/świadadzieniodawcy.

Lekarza lub świadczenniodawcę należy również informować o wszelkich zmianach masy ciała i/lub poziomu aktywności użytkownika.

Czyszczenie

Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych należy używać zwilżonej ściereczki oraz łagodnego mydła. NIE WOLNO stosować żrących środków czyszczących.

Pozostałe instrukcje w tej części są przeznaczone wyłącznie dla lekarza.

Taką konserwację może przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany personel (lekarz lub odpowiednio przeszkolony technik).

Rutynową konserwację przedstawioną poniżej należy przeprowadzać co najmniej raz w roku:

- Sprawdzić dokręcenie śrub zabezpieczających i śrub blokujących. Jeśli są poluzowane, śruby należy wykręcić, oczyścić, na gwint nałożyć klej Loctite 243, a następnie dokręcić właściwym momentem dokręcania, patrz punkt *Budowa*.
- Sprawdzać pod kątem defektów, które mogłyby niekorzystnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie wyrobu.

Należy upewnić się, że użytkownik przeczytał i zrozumiał wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji przeprowadzanej przez użytkownika.

Należy poinformować użytkownika, aby przeprowadzał regularną kontrolę wzrokową wyrobu, a wszelkie oznaki zużycia (nadmierne zużycie lub korozję), które mogą wpływać na jego funkcjonowanie, zgłaszał świadczeniodawcy.

Użytkownikowi należy zalecić, aby poinformował lekarza lub świadczenniodawcę o wszelkich zmianach swojej masy ciała i/lub poziomu aktywności.

Jeśli wyrób będzie używany do sportów ekstremalnych, należy zweryfikować poziom i częstotliwość konserwacji i w razie potrzeby uzyskać poradę i wsparcie techniczne, aby móc zaplanować nowy harmonogram konserwacji w zależności od częstotliwości i charakteru aktywności. Powinno to zostać określone po przeprowadzeniu lokalnej oceny ryzyka przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

6 Ograniczenia w użytkowaniu

Przewidywany okres eksploatacji

Miejscową ocenę ryzyka należy przeprowadzić na podstawie aktywności i użytkowania.

Podnoszenie ciężkich przedmiotów

Masa ciała i aktywność użytkownika podlegają wcześniej wymienionym ograniczeniom.

Podnoszenie ciężkich przedmiotów przez użytkownika musi zostać poprzedzone indywidualną oceną ryzyka.

Środowisko

Niniejszy wyrób może być używany jako proteza stosowana pod prysznicem, ale nie jest on przeznaczony do długotrwalego zanurzenia w wodzie. W przypadku kontaktu tego wyrobu ze słoną lub chlorowaną wodą należy go przepłukać wodą słodką i wysuszyć. Niewielkie ogniska korozji na powierzchni wyrobu nie mają wpływu na działanie i bezpieczeństwo stosowania tego wyrobu. W przypadku stwierdzenia poważnych oznak korozji, należy zaprzestać korzystania z tego wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Wyrób może być użytkowany wyłącznie w temperaturach od -15°C do 50°C.



Można używać pod prysznicem

7 Montaż i osiowanie


Instrukcje w tej części są przeznaczone wyłącznie dla lekarza.

Wyregulować i wyrównać poszczególne komponenty w celu zoptymalizowania działania i komfortu. Umieścić tak blisko, jak to możliwe względem osi symetrii protezy.

Dynamiczny pylon




938306

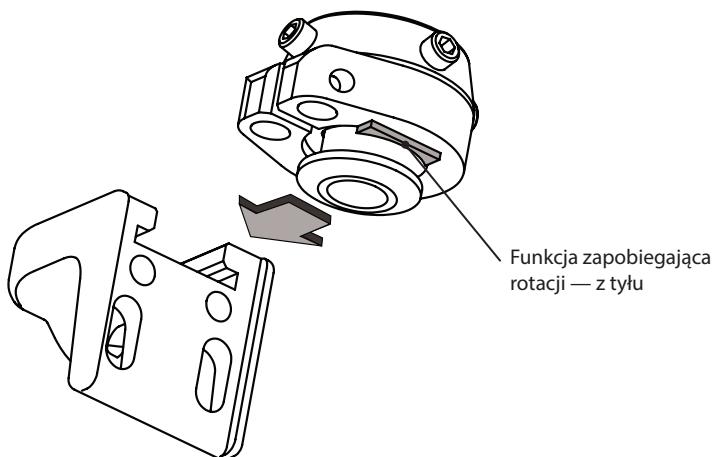


Przegub kolanowy Mercury




938251




Funkcja
zapobiegająca
rotacji — z przodu

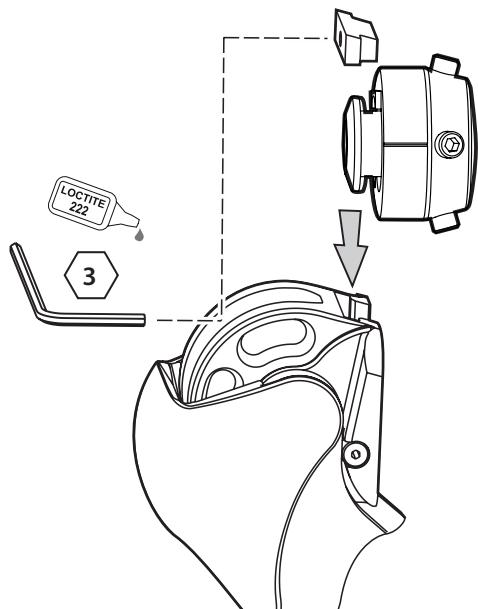


Obudowa 4-śrubowa ESK+



938205



Funkcja
zapobiegająca
rotacji — z przodu

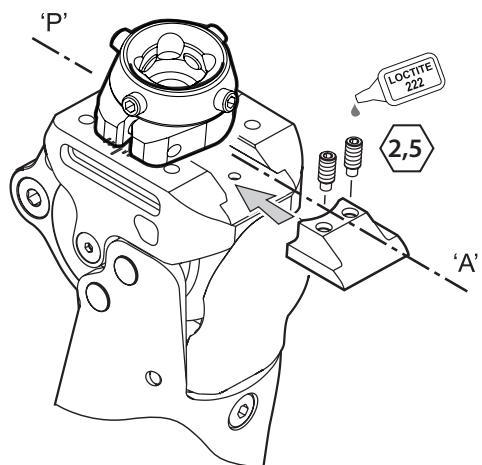


Linx, Orion3




938353



938374

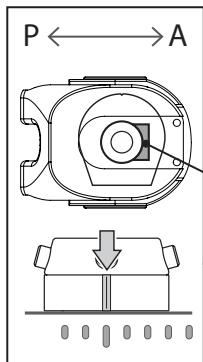


Funkcja
zapobiegająca
rotacji —
z przodu

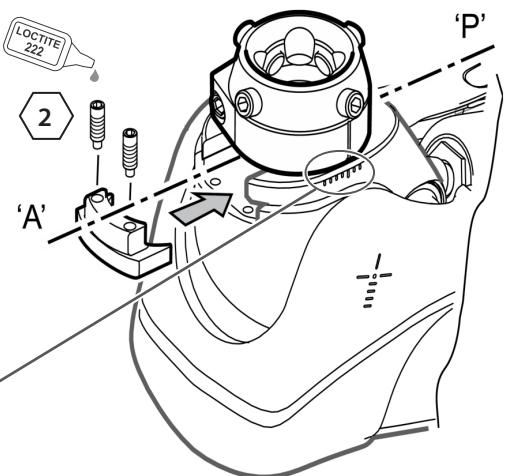


KX06V2



938409



Funkcja
zapobiegająca
rotacji —
z przodu

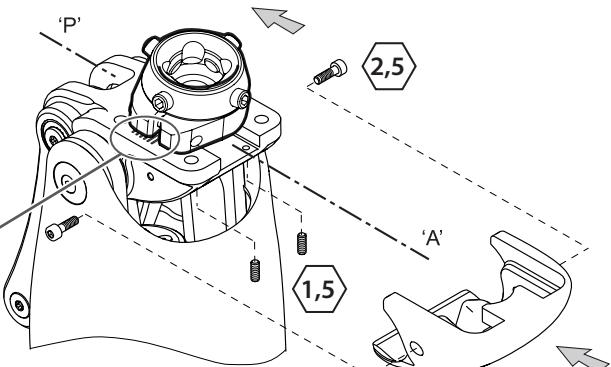


8 Specyfikacja techniczna

Zakres temperatur roboczych i przechowywania:	-15°C do 50°C
Waga wyrobu:	114 g
Poziom aktywności:	1–4
Maksymalna masa ciała użytkownika:	166 kg
Wysokość:	28 mm
Typ mocowania:	Dystalne — obudowa szczelinowa lub górną obudową Proksymalne — złącze piramidalne żeńskie (Blatchford)
Zakres regulacji:	Obrót w zakresie 360° Odchylenie od pionu ±7°
Przesunięcie w płaszczyźnie A-P:	15 mm (dynamiczny pylon) 15 mm (przegub kolanowy Mercury) 6 mm (obudowa 4-śrubowa ESK+) 8 mm (Linx, Orion3) 15 mm (KX06V2)

Wysokość

Wysokość wyrobu jest stała.

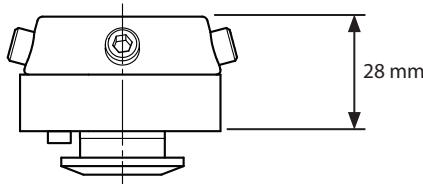

Przechowywanie i obsługa

W przypadku długotrwałego przechowywania należy upewnić się, że wyrób nie ma styczności z wilgocią i jest przechowywany w temperaturze pokojowej.

9 Składanie zamówień

Wyrób	Numer części
Adapter z przesuwnym złączem piramidalnym żeńskim	189128

Zakres odpowiedzialności

Producent zaleca korzystanie z niniejszego wyrobu wyłącznie w określonych warunkach i zgodnie z przeznaczeniem. Niniejszy wyrób należy poddawać konserwacji zgodnie z załączonymi instrukcjami dla użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki stosowania nieautoryzowanych połączelementów.

Deklaracja zgodności WE

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 dla wyrobów medycznych. Produkt został sklasyfikowany jako wyrób klasy I zgodnie z zasadami klasyfikacji określonymi w załączniku VIII do tego rozporządzenia. Deklaracja zgodności CE została opublikowana na stronie internetowej: www.blatchford.co.uk



Wyrób medyczny



Do wielokrotnego użycia u jednego pacjenta

Kompatybilność

Kompatybilność z produktami marki Blatchford została potwierdzona na podstawie testów przeprowadzonych zgodnie z odpowiednimi normami i wymaganiami Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych, w tym testów strukturalnych, zgodności wymiarowej i monitorowanej wydajności w terenie.

Użytkowanie wyrobu w połączeniu z innymi produktami posiadającymi oznakowanie CE należy przetestować z uwzględnieniem udokumentowanej lokalnej oceny ryzyka przeprowadzonej przez lekarza.

Gwarancja

Wyrób jest objęty 24-miesięczną gwarancją.

Użytkownik powinien mieć świadomość, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone, mogą spowodować unieważnienie gwarancji, licencji na użytkowanie i wyłączeń.

Aktualną i pełną treść warunków gwarancji opublikowano na stronie internetowej firmy Blatchford.

Zgłaszcanie poważnych incydentów

W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia poważnego incydentu związanego ze stosowaniem tego wyrobu incydent należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi krajowemu.

Aspekty środowiskowe

Ten produkt został wykonany z materiału nadającego się do recyklingu. O ile jest to możliwe, komponenty należy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami.

Zachowanie etykiety z opakowania

Zaleca się, aby lekarz zachował etykietę z opakowania jako potwierdzenie dostarczenia wyrobu.

Potwierdzenia dotyczące znaków towarowych

Blatchford jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Blatchford Products Limited.

Adres siedziby producenta

Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, Wielka Brytania.

Índice	72
1 Descrição e finalidade	73
2 Informações de segurança.....	74
3 Componentes	75
4 Funcionamento.....	76
5 Manutenção	76
6 Limitações à utilização	77
7 Montagem e alinhamento	77
8 Dados técnicos.....	80
9 Informações para encomendas.....	80

1 Descrição e finalidade

Salvo indicação em contrário, estas instruções de utilização destinam-se ao ortoprotésico e ao utilizador.

O termo “dispositivo” é utilizado em referência ao Adaptador de pirâmide fêmea com deslocamento.

Leia e certifique-se de que comprehende estas instruções, com particular destaque para todas as informações de segurança e instruções de manutenção.

Aplicação

Este dispositivo deve ser utilizado exclusivamente como prótese modular de membro inferior e destina-se apenas a um único utilizador.

O dispositivo destina-se a ligar uma extremidade aberta do chassis ranhura do Blatchford ou a estrutura superior a um recetor de pirâmide macho. Isto permite o ajuste angular, de deslocamento e de rotação entre as duas partes de uma prótese.

Características

- Construção leve e robusta de titânio e alumínio

Nível de atividade

Este dispositivo é adequado para níveis de atividade 1 – 4 (aplicam-se limites de peso, consulte *Dados técnicos*). Existem exceções, naturalmente, e nas nossas recomendações pretendemos ter em conta circunstâncias especiais e individuais. Qualquer decisão neste sentido deve ser tomada de forma ponderada e com base em informação detalhada.

Nível de atividade 1

Possui a capacidade ou o potencial de utilizar uma prótese para as transferências ou deambulação em superfícies niveladas, com uma cadência fixa. Típico do deambulador doméstico com ou sem limitações.

Nível de atividade 2

Tem a capacidade ou o potencial de deambulação, sendo capaz de ultrapassar barreiras ambientais de nível baixo como, por exemplo, bermas, escadas, ou superfícies irregulares. Típico do deambulador comunitário com limitações.

Nível de atividade 3

Possui a capacidade ou o potencial de deambular com uma cadência variável. Típico do deambulador comunitário capaz de ultrapassar a maioria das barreiras ambientais e que, possivelmente, tem uma atividade profissional, terapêutica ou desportiva que exige a utilização de prótese para outras finalidades além da simples locomoção.

Nível de atividade 4

Possui a capacidade ou o potencial de deambulação protética que ultrapassa as competências básicas de deambulação, demonstrando elevado impacto, tensão ou níveis de energia. Típico das exigências protéticas de crianças, adultos ativos ou atletas.

Contraindicações

Não são conhecidas quaisquer contraindicações se utilizado de acordo com estas instruções.

Benefício clínico

Proporciona uma ligação entre os componentes da prótese que permite algum ajuste do alinhamento.

2 Informações de segurança



Este símbolo de aviso destaca as informações de segurança importantes que devem ser cuidadosamente respeitadas.



Quaisquer alterações no desempenho ou funcionamento da prótese (por exemplo, folga excessiva ou ruídos estranhos) devem ser comunicadas de imediato ao fornecedor.



Utilize sempre os corrimões, se existentes, seja para descer escadas ou em qualquer outra situação.



O dispositivo pode ser utilizado como prótese para o duche, mas não se destina a uma imersão prolongada. Após o contacto com a água, seque-a de imediato. Se este dispositivo entrar em contacto com água salgada ou com cloro, deve ser lavado com água limpa e seco. Certifique-se de que qualquer utilização do dispositivo em água respeita as condições indicadas na secção *Limitações à utilização*.



As operações de montagem, manutenção e reparação do dispositivo só devem ser levadas a cabo por um ortoprotésico devidamente qualificado.



O utilizador não deve ajustar nem alterar a configuração do dispositivo.



O utilizador deve ser aconselhado a contactar o ortoprotésico caso haja alguma alteração na sua situação.



De forma a minimizar o risco de lesão provocada por uma falha ou falta de aperto das ligações com parafusos, certifique-se de que as roscas dos parafusos são cuidadosamente limpas antes de cada instalação.




Aperte sempre os parafusos de acordo com o binário de aperto indicado.

3 Componentes

Peças principais

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Pirâmide fêmea | Titânia |
| • Aro/anel de fixação | Liga de alumínio |
| • 4 parafusos de retenção da pirâmide | Aço zinkado |
| • Parafuso de fixação e inserções | Aço zinkado |

Identificação dos componentes

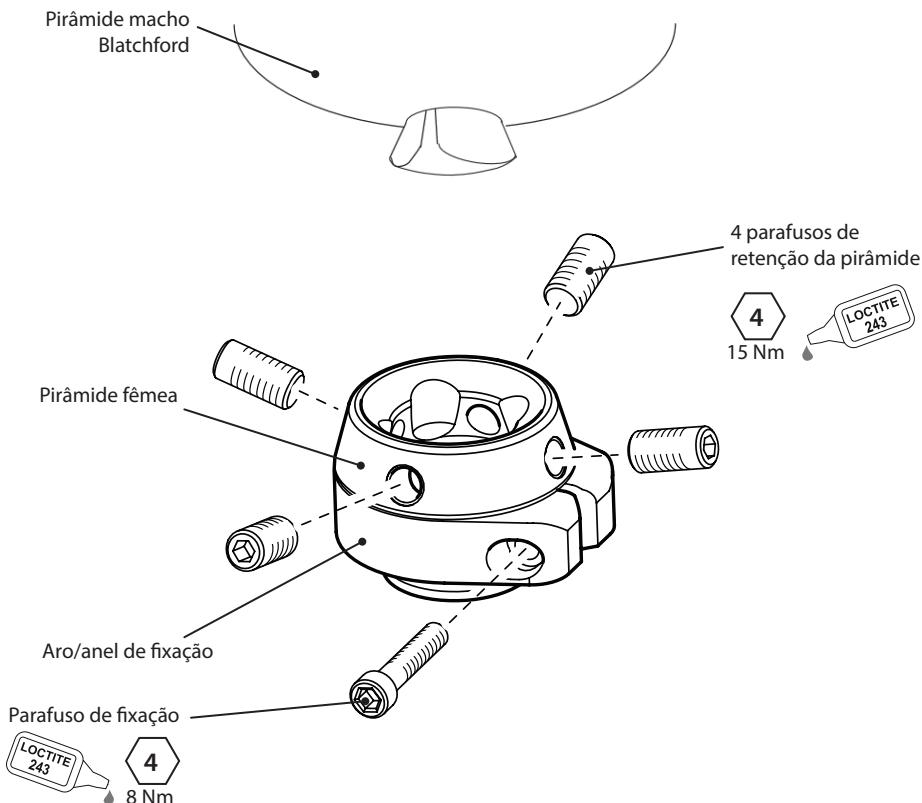

4 Funcionamento

Este dispositivo é composto por dois componentes principais. O movimento entre estes dois componentes antes do aperto dos parafusos da pirâmide e do parafuso de fixação permite alinhar a prótese de modo a adaptar-se aos requisitos individuais do utilizador. Quando o dispositivo está bem apertado com Loctite 243 e o binário de aperto indicado, este oferece uma forma segura de unir as duas partes de uma prótese.

5 Manutenção

Inspecione visualmente o dispositivo com regularidade.

Comunique quaisquer alterações no desempenho deste dispositivo ao ortoprotésico/fornecedor (por exemplo, ruídos estranhos, movimento ou desgaste significativo).

Informe o ortoprotésico/fornecedor de quaisquer alterações no peso corporal e/ou nível de atividade.

Limpeza

Utilize um pano húmido e sabão suave para limpar as superfícies exteriores. NÃO utilize produtos de limpeza agressivos.

As restantes instruções nesta secção destinam-se apenas ao ortoprotésico.

Esta manutenção deve ser realizada apenas por técnicos qualificados (ortoprotésico ou técnico com formação adequada).

Deve realizar os seguintes trabalhos de manutenção, pelo menos, uma vez por ano:

- Verifique se os parafusos de fixação e os parafusos de bloqueio estão bem apertados. Se estiver desapertado, retire, limpe, aplique Loctite 243 e aperte de acordo com o binário de aperto adequado, consulte a secção *Componentes*.
- Verifique se existem defeitos que possam afetar o funcionamento adequado.

Certifique-se de que o utilizador leu e compreendeu todas as informações de segurança e manutenção ao nível do utilizador.

Aconselhe o utilizador a efetuar regularmente uma inspeção visual do dispositivo e, caso detete sinais de desgaste que possam afetar o funcionamento, deve comunicar esse facto ao fornecedor (por exemplo, desgaste significativo ou corrosão).

Aconselhe o utilizador a informar o ortoprotésico/fornecedor de quaisquer alterações no peso corporal e/ou nível de atividade.

Se este dispositivo for utilizado para uma atividade extrema, é necessário rever o nível e o intervalo de manutenção e, se necessário, deve receber aconselhamento e apoio técnico para planejar um novo cronograma de manutenção em função da frequência e natureza da atividade. Tal deve ser decidido mediante uma avaliação de riscos local levada a cabo por uma pessoa devidamente qualificada.

6 Limitações à utilização

Vida útil prevista

Deve ser efetuada uma avaliação de riscos local com base na atividade e utilização.

Levantamento de pesos

O peso e a atividade do utilizador estão condicionados aos limites indicados.

O peso que o utilizador pode transportar deve basear-se numa avaliação de riscos local.

Ambiente

Este dispositivo pode ser utilizado como prótese para o duche, mas não se destina a uma imersão prolongada. Se este dispositivo entrar em contacto com água salgada ou com cloro, deve ser lavado com água limpa e secado. Uma corrosão ligeira na superfície não irá afetar o funcionamento nem a segurança deste dispositivo. No entanto, em caso de corrosão grave, deixe de utilizar este dispositivo e contacte o seu ortoprotésico.

Utilizar apenas entre -15 °C e 50 °C.



Adequado para utilização no duche

7 Montagem e alinhamento


As instruções nesta secção destinam-se apenas ao ortoprotésico.

Ajuste o alinhamento dos componentes para otimizar o funcionamento e conforto. Posicione o mais próximo possível da linha de construção.

Pilão dinâmico




938306

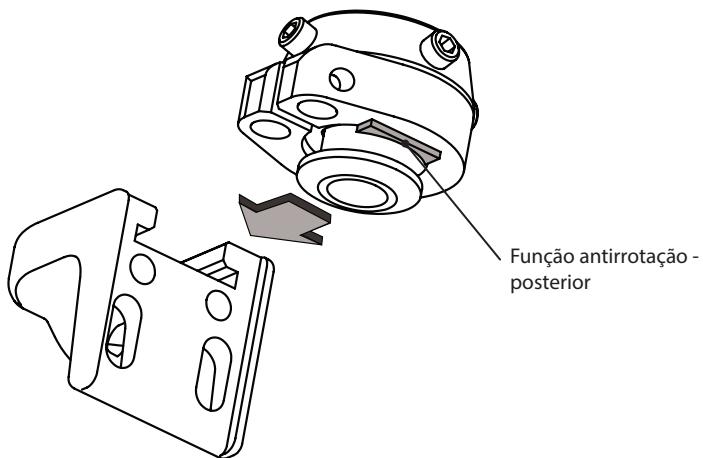


Joelho Mercury



938251




Função
antirrotação -
anterior

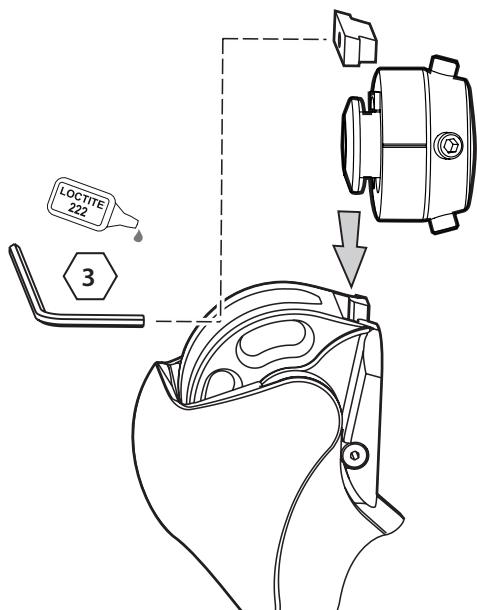


Chassis ESK+ de 4 parafusos



938205



Função
antirrotação -
anterior

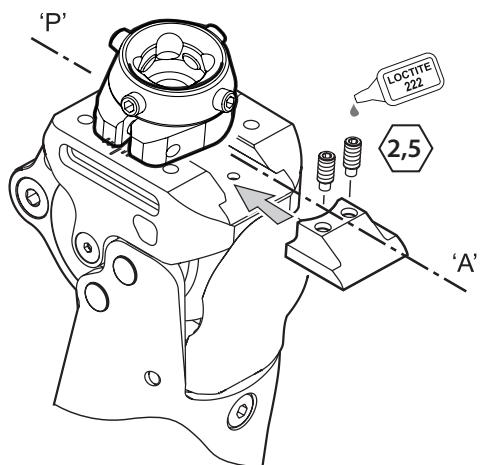


Linx, Orion3




938353



938374

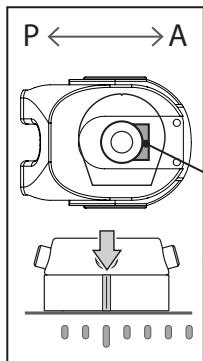


Função
antirrotação -
anterior

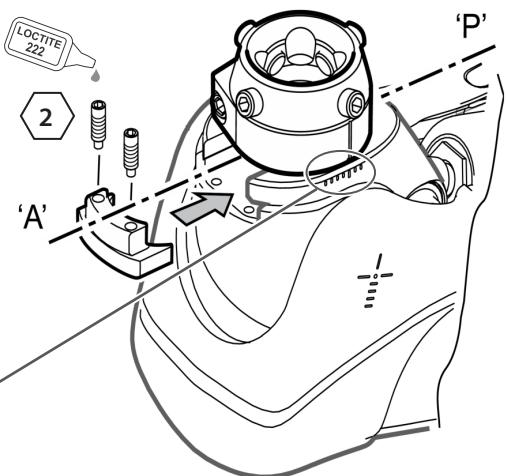


KX06V2



938409



Função
antirrotação -
anterior

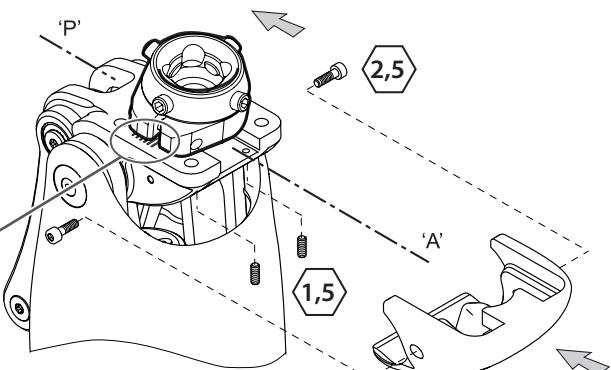


8 Dados técnicos

Intervalo de temperatura de funcionamento e armazenamento:	-15 °C a 50 °C
Peso do componente:	114 g
Nível de atividade:	1–4
Peso máximo do utilizador:	166 kg
Altura de construção:	28 mm
Tipo de fixação:	Distal – Chassis ranhurado ou estrutura superior Proximal – Pirâmide fêmea (Blatchford)
Intervalo de ajuste:	Rotação 360° Inclinação ±7° na vertical
Deslocamento AP:	15 mm (pilão dinâmico) 15 mm (joelho Mercury) 6 mm (chassis ESK+ de 4 parafusos) 8 mm (Linx, Orion3) 15 mm (KX06V2)

Altura de construção

A altura do dispositivo é fixa.

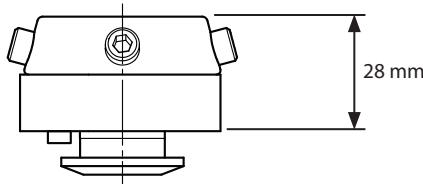

Armazenamento e manuseamento

Ao armazenar o produto durante longos períodos, certifique-se de que este não tem humidade e que é armazenado à temperatura ambiente.

9 Informações para encomendas

Dispositivo	Referência
Adaptador de pirâmide fêmea com deslocamento	189128

Responsabilidade

O fabricante recomenda utilizar o dispositivo apenas nas condições especificadas e para os fins previstos. A manutenção do dispositivo deve ser efetuada de acordo com as instruções de utilização fornecidas com o dispositivo. O fabricante não é responsável por quaisquer acontecimentos adversos que decorram da combinação de componentes não autorizados pelo mesmo.

Conformidade CE

Este produto cumpre os requisitos do Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos. Este produto foi classificado como um dispositivo da classe I, de acordo com as regras de classificação estipuladas no anexo VIII do referido regulamento. O certificado da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.blatchford.co.uk



Dispositivo médico



Um doente – utilização múltipla

Compatibilidade

A combinação com produtos da marca Blatchford está autorizada, desde que o produto da outra marca tenha sido testado em conformidade com as normas aplicáveis e o regulamento relativo a dispositivos médicos, nomeadamente o teste estrutural, a compatibilidade dimensional e o desempenho em campo controlado.

A combinação com outros produtos com a marcação CE apenas é permitida após a realização de uma avaliação de riscos local documentada por um ortoprotésico.

Garantia

O presente dispositivo está abrangido por uma garantia de 24 meses.

O utilizador deve estar informado de que as alterações ou modificações que não sejam expressamente autorizadas irão anular a garantia, as licenças de utilização e as isenções.

Consulte o website da Blatchford para aceder à versão integral da declaração de garantia em vigor.

Comunicação de incidentes graves

No caso improvável de ocorrer um incidente grave com este dispositivo, contacte o fabricante e a sua autoridade nacional competente.

Aspectos ambientais

Este produto é fabricado com material reciclável. Quando possível, os componentes devem ser reciclados de acordo com os regulamentos locais de manuseamento de resíduos.

Conservação do rótulo da embalagem

O ortoprotésico deverá guardar o rótulo da embalagem do dispositivo para efeitos de registo do dispositivo fornecido.

Declaração de marcas comerciais

Blatchford é uma marca registada da Blatchford Products Limited.

Sede social do fabricante

Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, RU.

Obsah	82
1 Popis a zamýšlený účel	83
2 Bezpečnostní informace	84
3 Konstrukce	85
4 Funkce	86
5 Údržba	86
6 Omezení použití	87
7 Sestavení a vyrovnání	87
8 Technické údaje	90
9 Informace pro objednávání	90

1 Popis a zamýšlený účel

Není-li uvedeno jinak, je tento návod k použití určen pro protetiky a uživatele.

Výraz *prostředek*, který se používá v celém návodu, označuje vnější posuvný pyramidový adaptér.

Přečtěte si prosím tyto pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte, zejména všechny bezpečnostní informace a pokyny pro údržbu.

Použití

Tento prostředek je určen k použití výhradně pro modulární protézy dolních končetin určené pro jednoho uživatele.

Prostředek je určen k připojení drážkovaného podvozku Blatchford s otevřeným koncem nebo horního pouzdra k pyramidovému. To umožňuje posuvné, úhlové a rotační nastavení mezi dvěma částmi končetin.

Vlastnosti

- Lehká, pevná, hliníková a titanová konstrukce

Stupeň aktivity

Tento prostředek je vhodný pro úrovně aktivity 1–4 (platí hmotnostní limity, viz *Technické údaje*). Samozřejmě existují výjimky a v našem doporučení umožňujeme přizpůsobení podle jedinečných, individuálních okolností, avšak takové rozhodnutí musí být učiněno na základě rádného a důkladného zdůvodnění.

Stupeň aktivity 1

Schopnost nebo předpoklady používat protézu pro přesuny nebo pohyb na rovných površích při konstantní rychlosti chůze. Typické pro limitovaný a nelimitovaný interiérový typ uživatele.

Stupeň aktivity 2

Schopnost nebo předpoklady pro chůzi se schopností překonávat malé přírodní nerovnosti a překážky, jako jsou obrubníky, schody nebo nerovné povrchy. Typické pro limitovaný exteriérový typ uživatele.

Stupeň aktivity 3

Schopnost nebo předpoklady pro pohyb s různou rychlostí chůze. Typické pro nelimitovaný typ exteriérového uživatele, který má schopnost překonat většinu přírodních nerovností a může mít odbornou, terapeutickou nebo cvičební aktivitu, která vyžaduje protetické využití nad rámec jednoduché lokomoce.

Stupeň aktivity 4

Schopnost nebo předpoklady protetické aktivity, která přesahuje základní pohybové dovednosti, s očekávanými výraznými rázy, namáháním nebo působením vysoké energie. Typické pro protetické požadavky dítěte, aktivního dospělého nebo sportovce.

Kontraindikace

Nejsou známy žádné kontraindikace při použití v souladu s těmito pokyny.

Klinický přínos

Poskytuje připojení mezi protetickými komponentami, které umožňují určité nastavení vyrovnání.

2 Bezpečnostní informace


-  Tento výstražný symbol označuje důležité bezpečnostní informace, které je třeba pečlivě dodržovat.
-  Jakékoli změny ve výkonu nebo funkci končetiny, tj. nadměrná vůle nebo neobvyklé zvuky, by měly být okamžitě nahlášeny poskytovateli protetických služeb.
-  Při chůzi ze schodů a vždy, když je k dispozici, používejte zábradlí.
-  Prostředek lze použít jako sprchovou protézu, ale není určen k dlouhodobému ponoření do vody. Po kontaktu s vodou jej ihned otřete do sucha. Pokud tento prostředek přijde do styku se slanou nebo chlorovanou vodou, měl by být opláchnut sladkou vodou a vysušen. Zajistěte, aby jakékoli použití prostředku ve vodě splňovalo podmínky uvedené v části *Omezení použití*.
-  Montáž, údržbu a opravy prostředku smí provádět pouze kvalifikovaný protetik.
-  Uživatel nesmí s nastavením prostředku manipulovat ani ho nijak upravovat.
-  Uživateli se doporučuje, aby v případě změny stavu kontaktoval svého protetika.
-  Abyste snížili riziko poranění v důsledku poruchy nebo uvolnění šroubových spojů, před každou instalací zajistěte důkladné vyčištění závitů.
-  Šrouby vždy utahuje stanoveným utahovacím momentem.

3 Konstrukce

Hlavní části

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| • Vnější pyramida | Titan |
| • Objímka / upínací kroužek | Hliníková slitina |
| • Seřizovací šrouby pyramidy | Pokovený šroub (4x) |
| • Upínací šroub a vložky | Pokovená ocel |

Identifikace komponenty

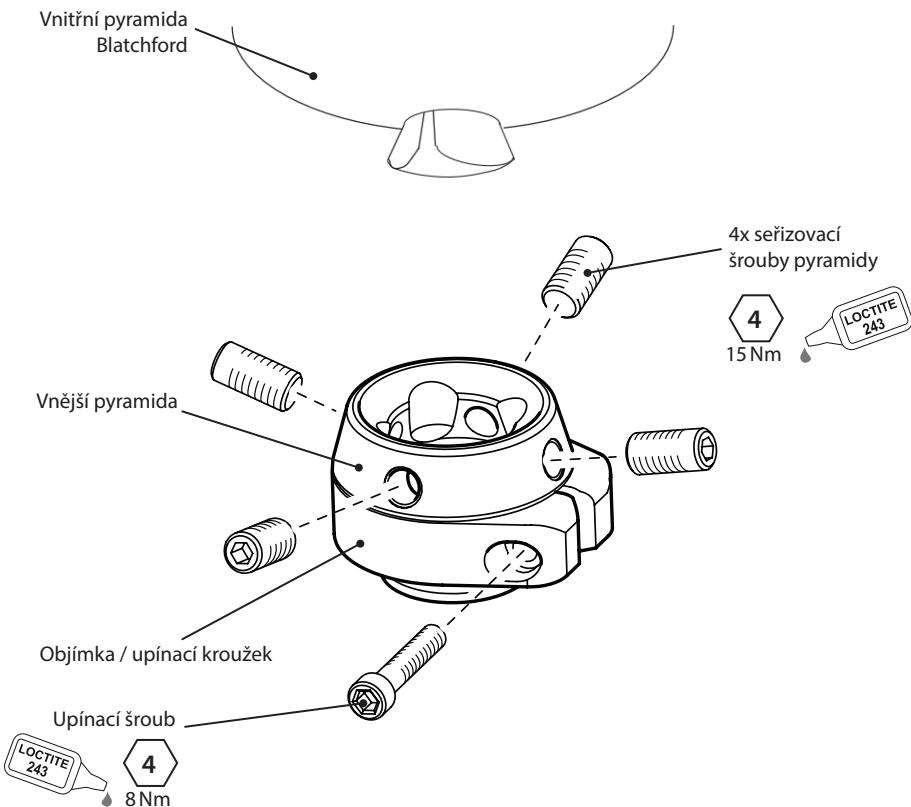

4 Funkce

Tento prostředek tvoří dvě hlavní součásti. Pohyb mezi těmito dvěma komponenty před utažením pyramidových šroubů a upínacího šroubu umožňuje vyrovnání končetiny tak, aby vyhovovalo konkrétnímu uživateli. Při bezpečném utažení za využití přípravku Loctite 243 a nastavení uvedeného momentu tento prostředek nabízí bezpečný způsob spojení dvou částí končetiny.

5 Údržba

Prostředek pravidelně vizuálně kontrolujte.

Nahlaste jakékoli změny ve výkonu tohoto prostředku protetikovi / poskytovateli protetických služeb, např. neobvyklé zvuky, pohyb nebo výrazné opotřebení.

Protetika / poskytovatele protetických služeb informujte o všech změnách tělesné hmotnosti a/nebo úrovni aktivity.

Čištění

K čištění vnějších povrchů použijte vlhký hadřík a jemné mýdlo. NEPOUŽÍVEJTE agresivní čisticí prostředky.

Zbývající pokyny v této části jsou určeny pouze pro protetiky.

Tuto údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný personál (protetik nebo vhodný vyškolený technik).

Následující běžná údržba musí být prováděna nejméně jednou ročně:

- Zkontrolujte dotažení upevňovacích a zajišťovacích šroubů. V případě uvolnění je uvolněte, vyjměte a vycistěte, potom naneste Loctite 243 a utáhněte na správný krouticí moment, viz část Konstrukce.
- Zkontrolujte vady, které by mohly mít vliv na správnou funkci.

Zajistěte, aby si uživatel přečetl a porozuměl všem bezpečnostním informacím a informacím o údržbě na úrovni uživatele.

Uživateli upozorněte, že se doporučuje pravidelná vizuální kontrola končetiny a že známky opotřebení, které by mohly mít vliv na funkci, je nutné nahlásit poskytovateli protetických služeb (např. významné opotřebení nebo koroze).

Poučte uživatele, aby protetika / poskytovatele protetických služeb informoval o všech změnách tělesné hmotnosti a/nebo úrovni aktivity.

Pokud je tento prostředek používán pro extrémní aktivity, musí být zkontovalována úroveň a interval údržby a v případě potřeby vyhledána rada a technická podpora pro plánování nového plánu údržby v závislosti na frekvenci a povaze činnosti. To by mělo být určeno místním hodnocením rizik provedeným vhodně kvalifikovanou osobou.

6 Omezení použití

Zamýšlená životnost

Místní hodnocení rizik by mělo být provedeno na základě aktivity a použití.

Zvedání břemen

Hmotnost a aktivity uživatele se řídí uvedenými limity.

Povolené zatížení uživatele by měla vycházet z místního posouzení rizik.

Prostředí

Prostředek lze použít jako sprchovou protézu, ale není určen k dlouhodobému ponoření do vody. Pokud tento prostředek přijde do styku se slanou nebo chlorovanou vodou, měl by být opláchnut sladkou vodou a vysušen. Lehká povrchová koroze neovlivňuje funkci ani bezpečnost tohoto prostředku. Pokud je však zjevná výrazná koroze, přestaňte tento prostředek používat a kontaktujte svého protetika.

Výhradně pro použití při teplotě -15 °C až 50 °C.



Vhodné pro použití ve sprše

7 Sestavení a vyrovnání


Pokyny v této části jsou určeny pouze pro protetiky.

Upřavte vyrovnání součástí pro optimalizaci funkce a pohodlí. Umístěte co nejbližší konstrukční linii.

Dynamický pylon





938306

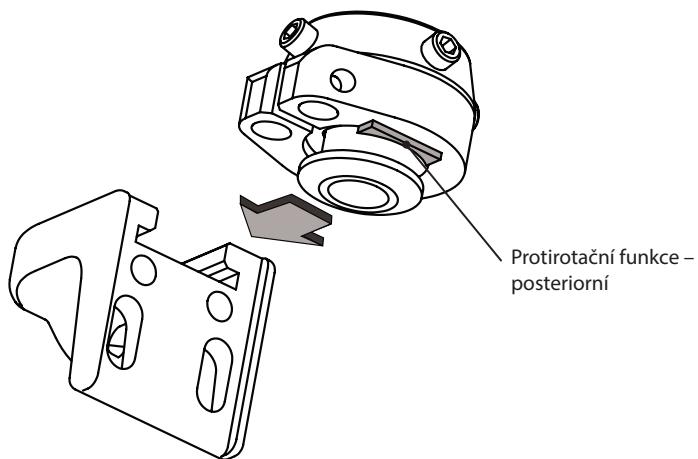

Koleno Mercury





938251

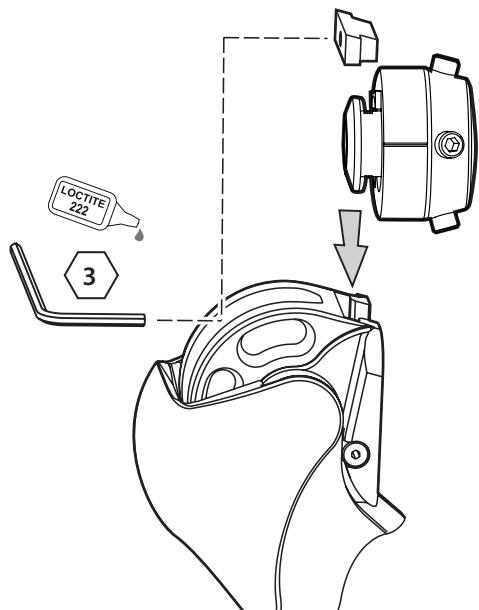

Podvozek ESK+ se 4 šrouby



938205

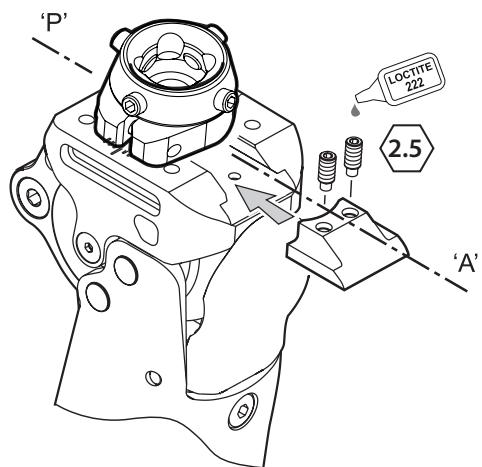


Linx, Orion3




938353



938374

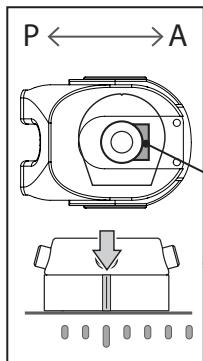


Protirotační funkce
– anteriorní

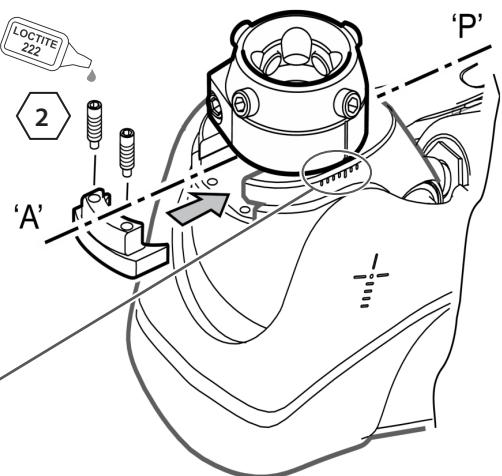


KX06V2



938409



Protirotační funkce
– anteriorní

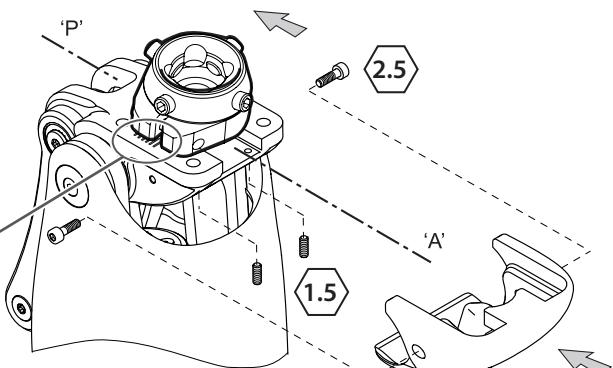


8 Technické údaje

Rozsah provozních a skladovacích teplot:	-15 °C až 50 °C
Hmotnost komponenty.	114 g
Stupeň aktivity:	1–4
Maximální hmotnost uživatele:	166 kg
Výška konstrukce:	28 mm
Typ nástavce:	Distální – drážkovany podvozek nebo horní kryt Proximální — vnější pyramida (Blatchford)
Rozsah seřízení:	Rotace 360° ±7 ° náklon od svislé roviny
Posun A–P:	15 mm (dynamický pylon) 15 mm (koleno Mercury) 6 mm (podvozek ESK+ se 4 šrouby) 8 mm (Linx, Orion3) 15 mm (KX06V2)

Výška konstrukce

Výška prostředku je fixní.

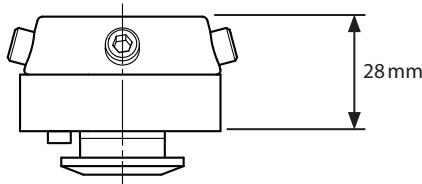

Skladování a manipulace

Při dlouhodobém skladování zajistěte, aby byl produkt suchý a skladován při pokojové teplotě.

9 Informace pro objednávání

Prostředek	Číslo dílu
Vnější posuvný pyramidový adaptér	189128

Zodpovědnost

Výrobce doporučuje používat prostředek pouze za stanovených podmínek a pro zamýšlené účely. Údržba prostředku musí být prováděna v souladu s pokyny k použití, které byly dodány s prostředkem. Výrobce nenese odpovědnost za jakýkoli nepříznivý výsledek způsobený kombinací komponent, které nebyly autorizovány.

Soulad CE

Tento produkt splňuje požadavky směrnice EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích. Tento produkt byl klasifikován jako produkt třídy I podle klasifikačních kritérií uvedených v příloze VIII tohoto předpisu. Prohlášení o shodě EU je dostupné na následující internetové adrese: www.blatchford.co.uk



Zdravotnický prostředek



Jeden pacient – více použití

Kompatibilita

Kombinace se značkovými produkty Blatchford je schválena na základě testování v souladu s příslušnými normami a MDR, včetně strukturálních zkoušek, rozměrové kompatibility a sledovaného výkonu v terénu.

Kombinace s alternativními produkty s označením CE musí být provedena s ohledem na zdokumentované místní posouzení rizik provedené protetikem.

Záruka

Na tento prostředek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců.

Uživatel by si měl být vědom, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny, mohou zrušit platnost záruky, provozních licencí a výjimek.

Aktuální úplné prohlášení o záruce naleznete na webových stránkách společnosti Blatchford.

Hlášení vážných nehod

V nepravděpodobném případě, že dojde k vážné nehodě v souvislosti s tímto prostředekem, měla by být nahlášena výrobci a příslušnému národnímu orgánu.

Aspekty životního prostředí

Tento produkt je vyroben z recyklovatelného materiálu. Pokud je to možné, měly by být komponenty recyklovány v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.

Uchování štítku na obalu

Protetikovi se doporučuje uchovat štítek na obalu jako záznam o dodaném prostředku.

Uznání ochranné známky

Blatchford je registrovaná ochranná známka společnosti Blatchford Products Limited.

Sídlo výrobce

Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, Spojené království.

blatchford.co.uk/distributors

Blatchford Products Ltd.

Unit D Antura
Kingsland Business Park
Basingstoke
RG24 8PZ
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0) 1256 316600
Fax: +44 (0) 1256 316710
Email: customer.service@
blatchford.co.uk
www.blatchford.co.uk

Blatchford Europe GmbH

Am Prime-Parc 4
65479 Raunheim
GERMANY
Tel: +49 (0) 9221 87808 0
Fax: +49 (0) 9221/87808 60
Email: info@blatchford.de
www.blatchford.de
Email: contact@blatchford.fr
www.blatchford.fr

Endolite India Ltd.

A4 Naraina Industrial Area
Phase - 1
New Delhi
INDIA – 110028
Tel: +91 (011) 45689955
Fax: +91 (011) 25891543
Email: endolite@vsnl.com
www.endoliteindia.com

Blatchford Inc.

1031 Byers Road
Miamisburg
Ohio 45342
USA
Tel: +1 (0) 800 548 3534
Fax: +1 (0) 800 929 3636
Email: info@blatchfordus.com
www.blatchfordus.com

Ortopro AS

Hardangervegen 72
Seksjon 17
5224 Nesttun
NORWAY
Tel: +47 (0) 55 91 88 60
Email: post@ortopro.no
www.ortopro.no

EC REP

Blatchford Europe GmbH
Am Prime-Parc 4
65479 Raunheim Germany

